



Время измерения	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
00:00-06:00	С	337	Оборудование находится в поверке	100.0	3.0	50.0
06:00-12:00	ССЗ	330	Оборудование находится в поверке	150.0	150.0	150.0
12:00-18:00	СЗ	324	Оборудование находится в поверке	0.0004	0.0004	0.0004
18:00-24:00	СЗ	317	Оборудование находится в поверке	0.0004	0.0004	0.0004
00:00-24:00	ССЗ	332	Оборудование находится в поверке	0.0004	0.0004	0.0004
ПДК, с						


Формальдегид, мг/м³

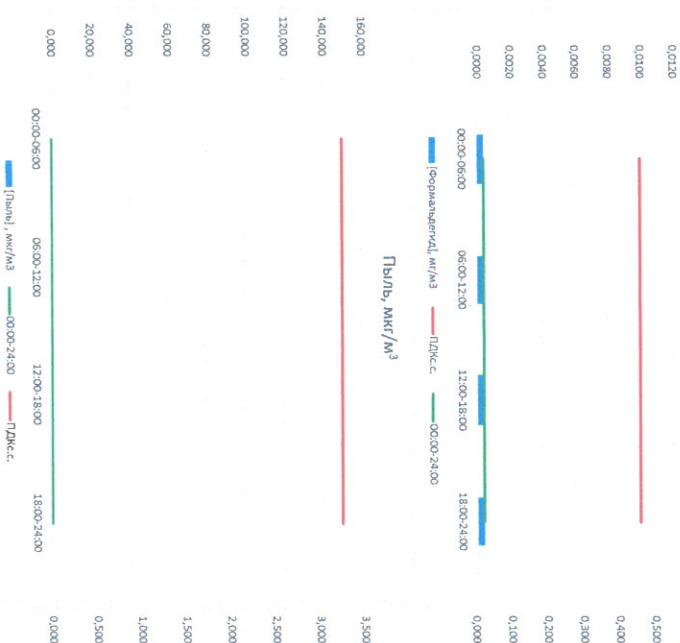


NO, мкг/м³

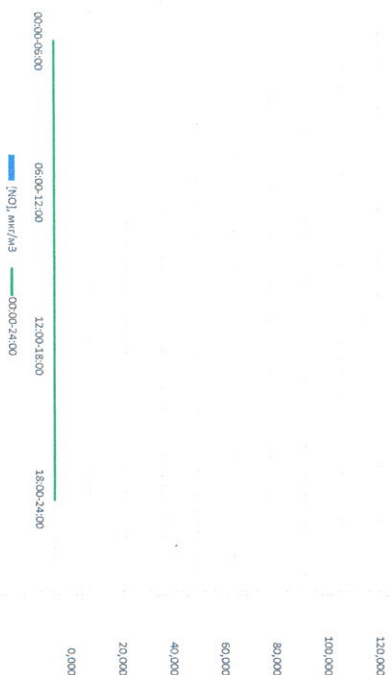


NO₂, мкг/м³

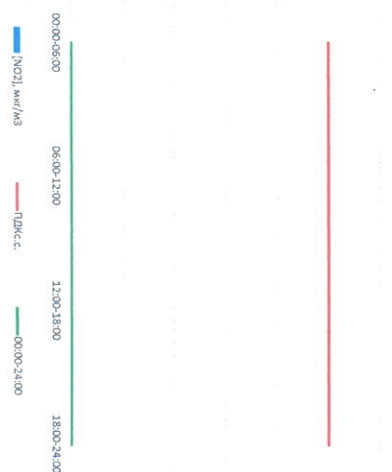


CO, мг/м³

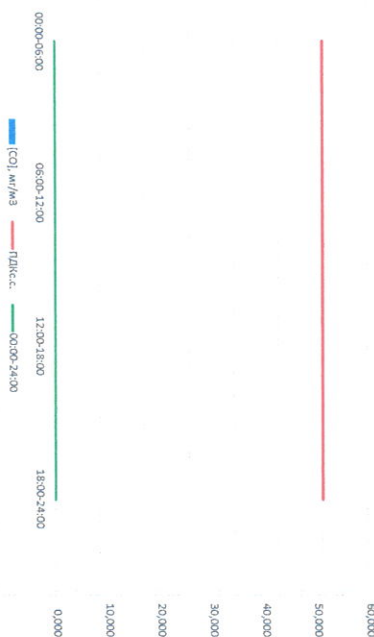

SO₂, мкг/м³

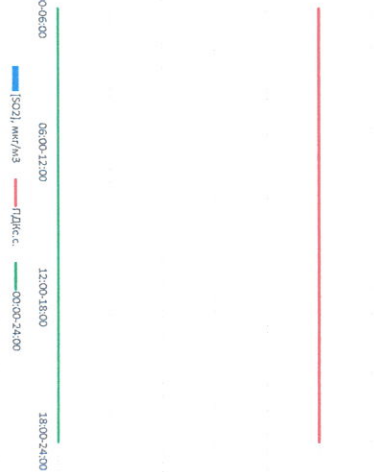

Пыль, мкг/м³

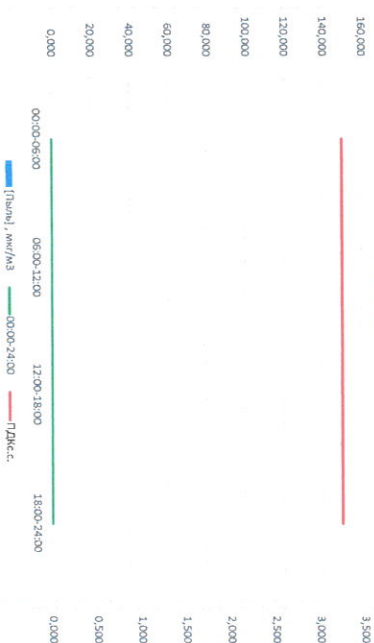

Врио руководителя филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

В.Н. Горбунова

Начальник лаборатории

В.Н. Пронина

