



Направление ветра	NO ₂ , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	CO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	NO ₂ 204	3,911	8,489	0,001	2,912	20,511
06:00-12:00	СЭС 295	0,000	3,181	0,000	2,367	23,982
12:00-18:00	СЭС 295	0,000	3,093	0,000	0,140	11,268
18:00-24:00	З 275	0,000	5,694	0,034	1,494	8,573
00:00-24:00	З 267	0,978	5,114	0,009	1,728	16,109
ПДК _{с.с.}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						Оборудование находится в поверке 0,01

Формальдегид, мкг/м³

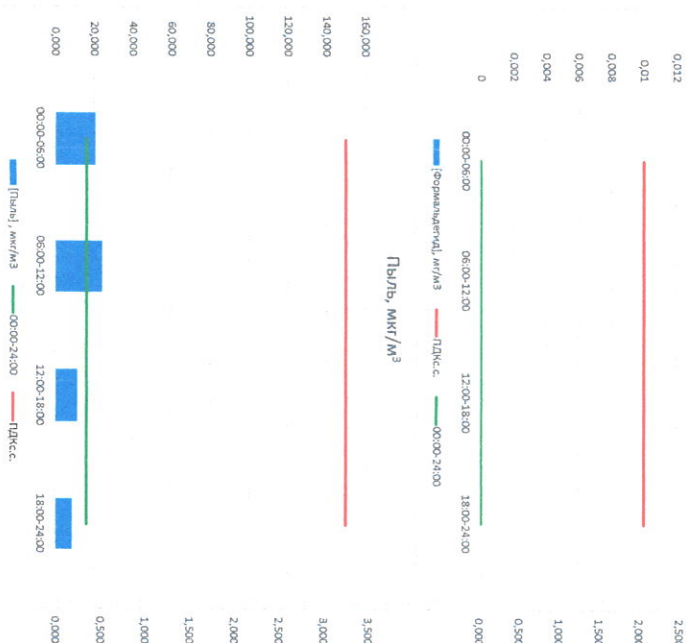


NO, мкг/м³

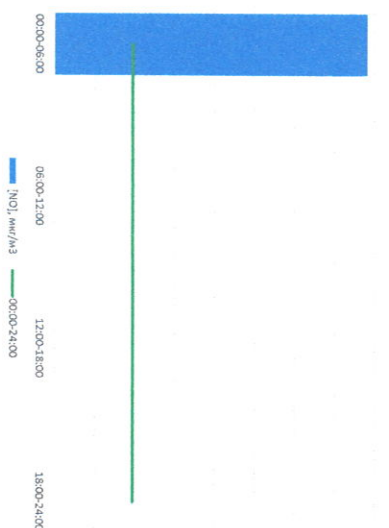


NO₂, мкг/м³



CO, мкг/м³

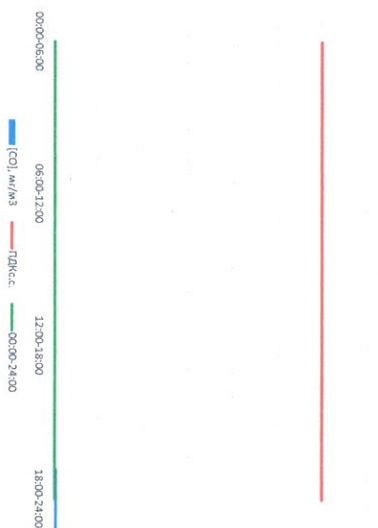

SO₂, мкг/м³

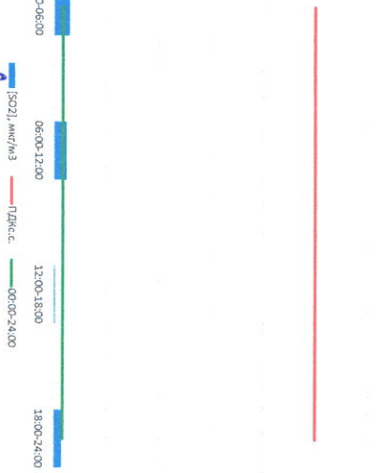

Врио руководителя филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

В.Н. Горбунова

Не назначен лаборатория

Ю.А. Чернина

