



Время измерения	[NO _x], мкг/м ³	[NO ₂], мкг/м ³	[CO], мкг/м ³	[CO ₂], мкг/м ³	[Пыль], мкг/м ³	Оборудование находится в проверке	
00:00-06:00	3	270	0,000	6,032	0,258	4,508	10,544
06:00-12:00	3	274	0,000	3,909	0,162	2,870	14,784
12:00-18:00	3	279	0,000	4,768	0,138	0,716	23,967
18:00-24:00	3	269	2,086	7,399	0,162	3,778	13,587
00:00-24:00	3	273	0,522	5,527	0,180	2,968	15,721
ПДК _с	-	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
							0,01


Формальдегид, мкг/м³

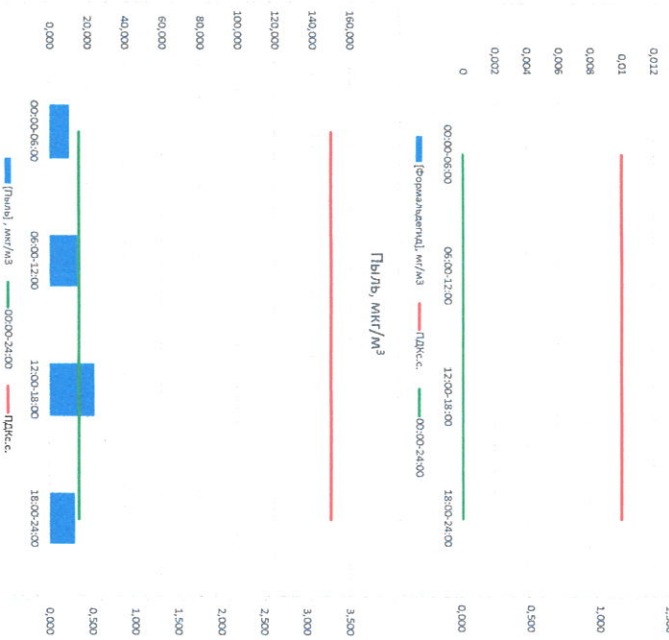


NO, мкг/м³

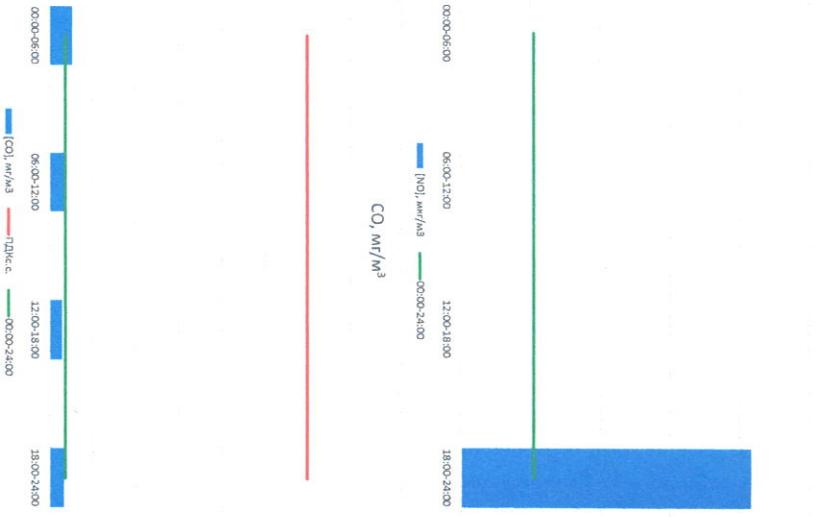


NO₂, мкг/м³

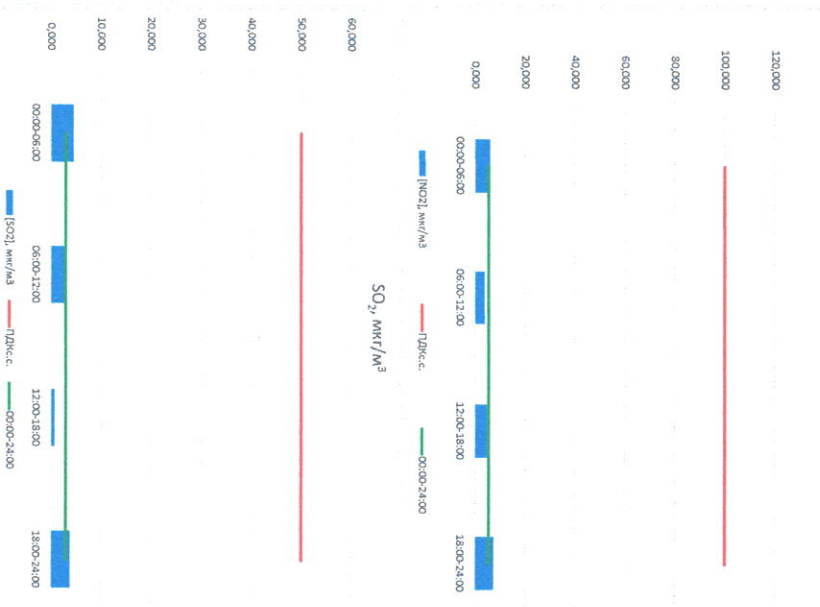

CO, мкг/м³

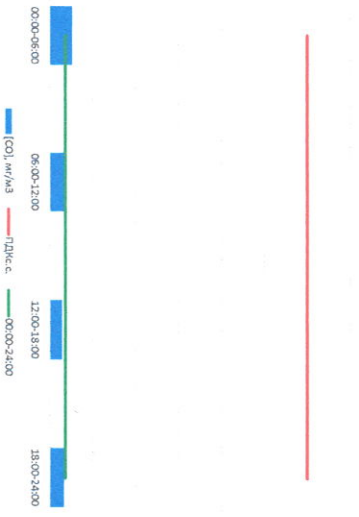

SO₂, мкг/м³

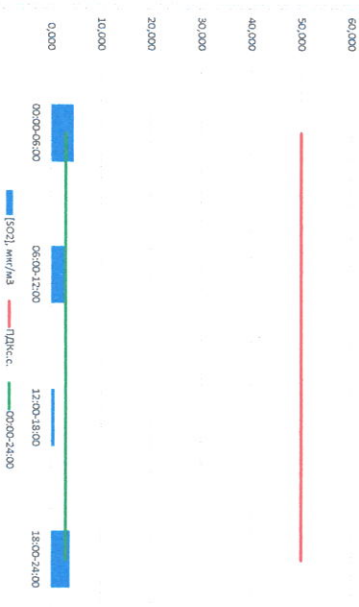

Руководитель филиала ЦЛТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

