


Наименование станции	NO _x , мкг/м ³	NO ₂ , мкг/м ³	CO, мкг/м ³	SO ₂ , мкг/м ³	Пыль, мкг/м ³	Формальдегид, мкг/м ³
00:00-06:00	NO 191					
06:00-12:00	NO ₂ 234					
12:00-18:00	NO ₂ 246					
18:00-24:00	NO ₂ 269					
00:00-06:00	NO ₂ 235					
ПДК, с						


Формальдегид, мкг/м³



NO_x, мкг/м³

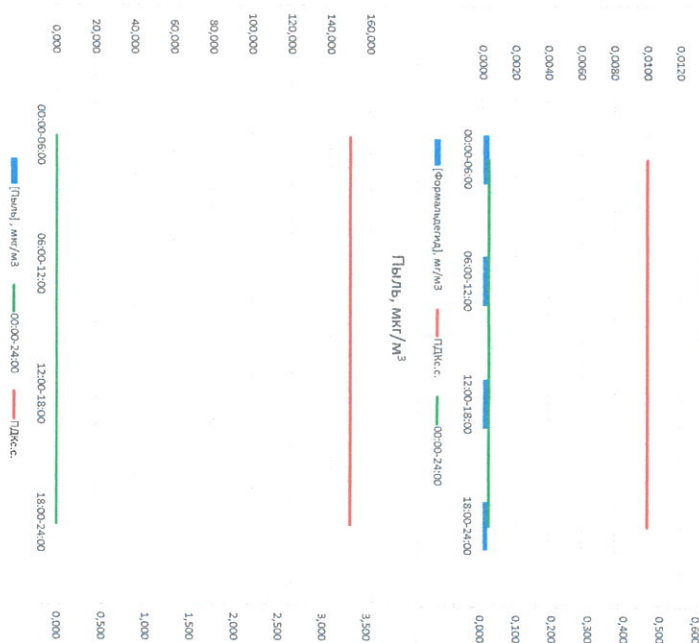

NO₂, мкг/м³

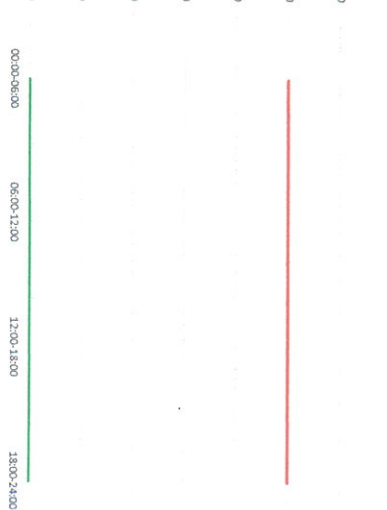


CO, мкг/м³



SO₂, мкг/м³



Пыль, мкг/м³

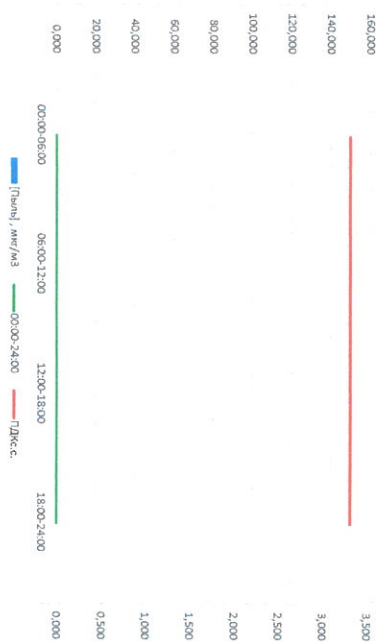

Руководитель филиала ЦПАТИ по Смоленской области

Ю.Л. Есенин

Начальник лаборатории

В.Н. Прокопченко

