



| Время       | NO <sub>x</sub> , мкг/м³ | NO <sub>2</sub> , мкг/м³ | CO, мкг/м³ | SO <sub>2</sub> , мкг/м³ | Пыль, мкг/м³ | Формальдегид, мкг/м³              |
|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 00:00-06:00 | NO 190                   | 0,000                    | 3,494      | 0,185                    | 4,444        | 5,597                             |
| 06:00-12:00 | NO <sub>2</sub> 192      | 0,001                    | 6,195      | 0,236                    | 4,181        | 11,956                            |
| 12:00-18:00 | NO <sub>2</sub> 217      | 0,000                    | 5,403      | 0,146                    | 0,684        | 14,129                            |
| 18:00-24:00 | NO <sub>2</sub> 210      | 0,000                    | 7,144      | 0,149                    | 0,750        | 10,456                            |
| ПДК, %      | -                        | -                        | 100,0      | 3,0                      | 50,0         | 150,0                             |
|             |                          |                          |            |                          |              | Оборудование находится в проверке |
|             |                          |                          |            |                          |              | 0,01                              |


Формальдегид, мкг/м³

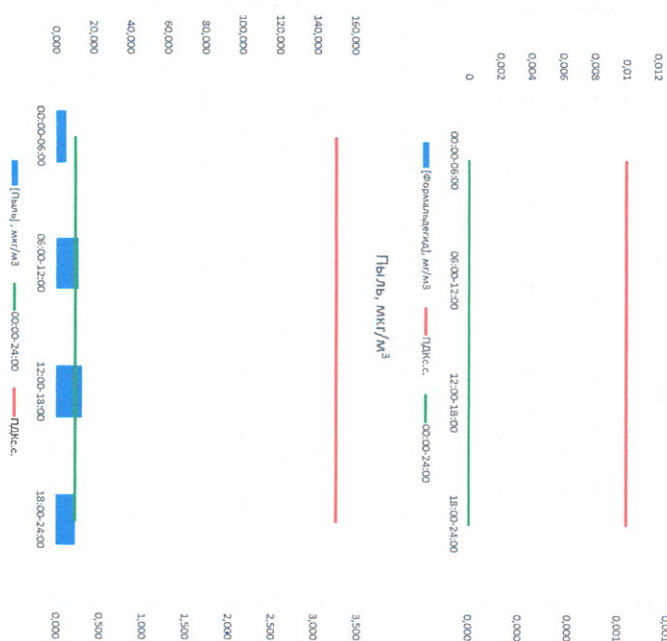


NO<sub>x</sub>, мкг/м³

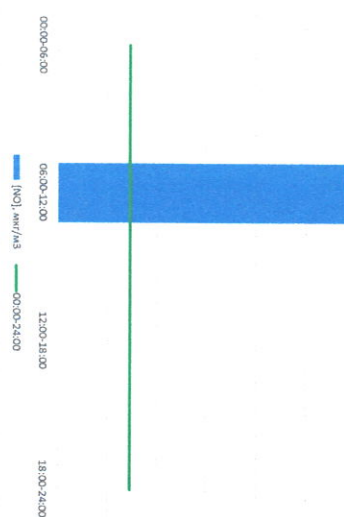


NO<sub>2</sub>, мкг/м³

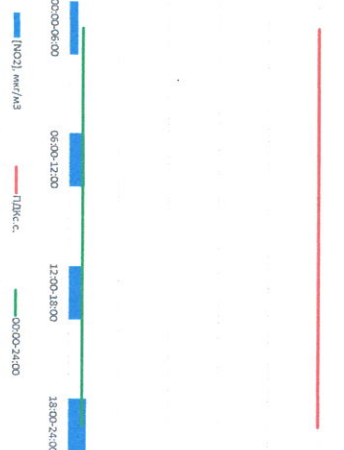

CO, мкг/м³

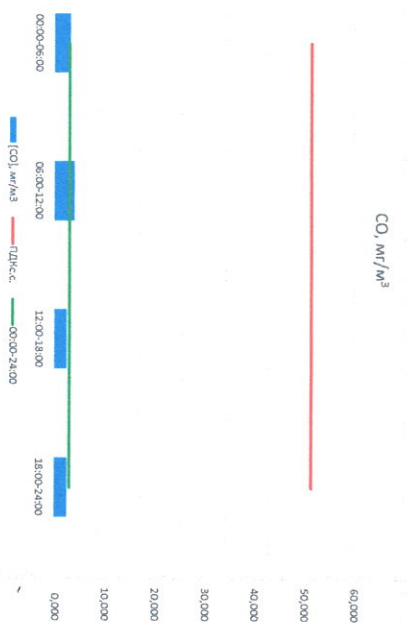

SO<sub>2</sub>, мкг/м³

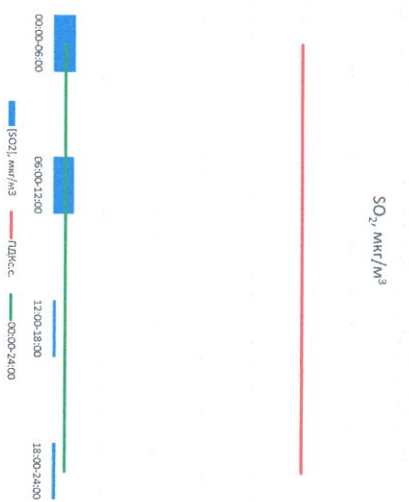

Руководитель филиала ЦПАТИ по Смоленской области

*[Signature]*

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

*[Signature]*

В.Н. Прохорова

