


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 20.01.2021 г.


Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³
00:00-06:00	3ЮЗ	-	0,290	-	-
06:00-12:00	Ю	-	0,519	-	-
12:00-18:00	Ю	-	0,303	-	-
18:00-24:00	ЮВ	-	0,447	-	-
00:00-24:00	Ю	-	0,390	-	-
ПДК _{г.с.}	60,0	40,0	3,0	50,0	150,0

Приборы, находящиеся в поверке на момент выдачи отчета
 Модуль АС 32М (АСПК) Хемилюминесцентный анализатор оксидов азота
 Модуль АР22 (АСПК) УФ флуоресцентный анализатор диоксида серы
 МР101М Бета-измеритель взвешенных частиц


NO, мкг/м³

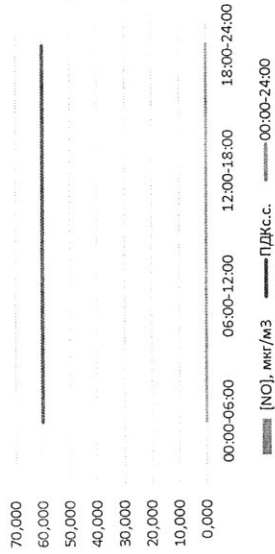


NO₂, мкг/м³

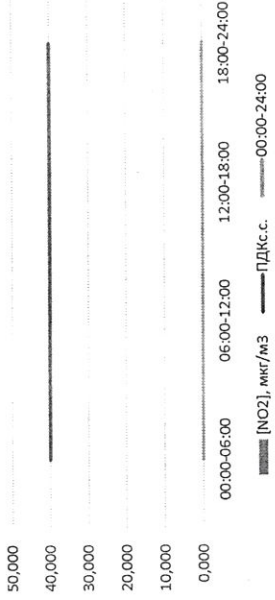


Пыль, мкг/м³

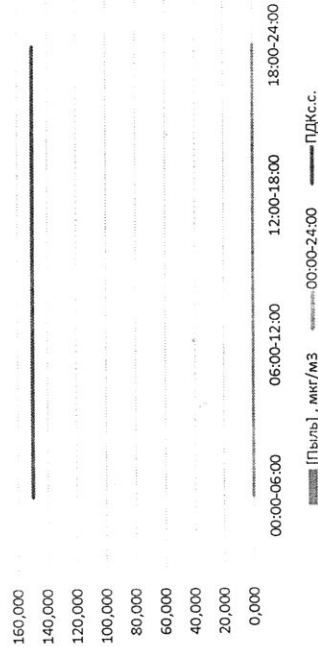

CO, мг/м³

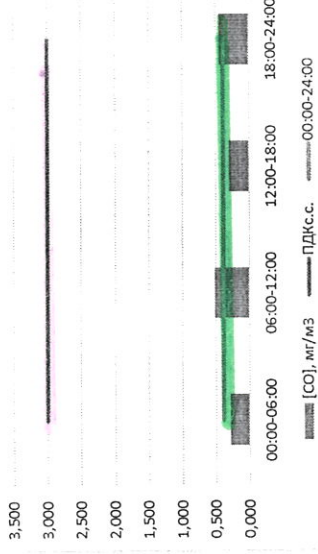

SO₂, мкг/м³

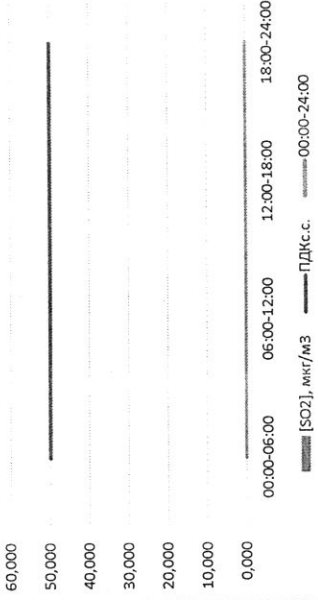

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области



Начальник отдела - заведующий лабораторией

С.В. Бобкова