



	NO _x , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	PM ₁₀ , мкг/м³	PM _{2.5} , мкг/м³	Оборудование находится в поверке	
00:00-06:00	303	257	0,000	4,337	0,120	1,127	8,795
06:00-12:00	303	255	0,001	4,097	0,121	0,820	10,385
12:00-18:00	303	209	0,019	5,647	0,143	0,372	8,775
18:00-24:00	303	202	7,657	13,486	0,156	2,241	16,891
00:00-24:00	303	231	1,919	6,892	0,135	1,140	10,711
ПДК _с	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

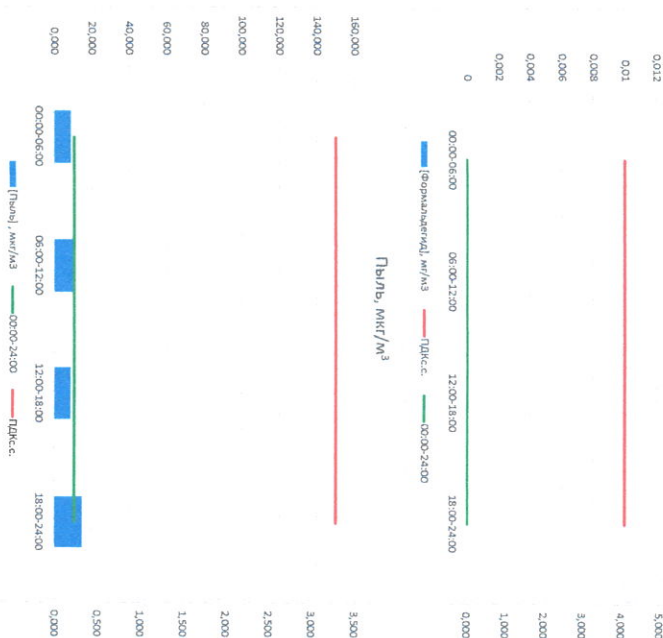


NO, мкг/м³

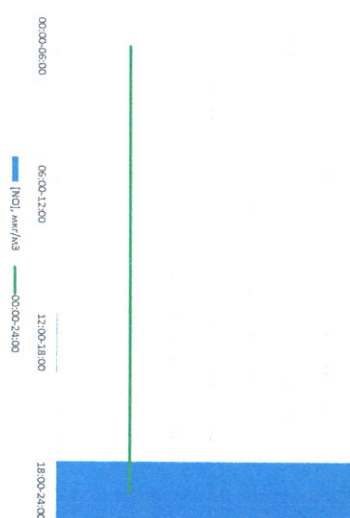


NO₂, мкг/м³

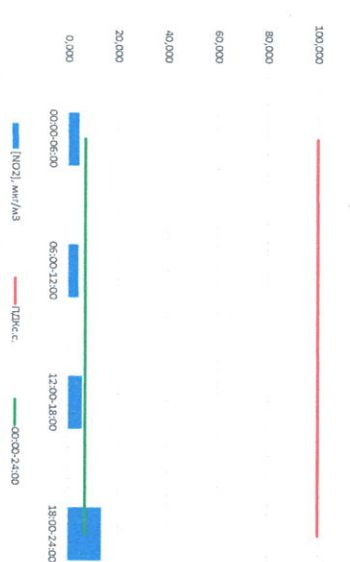


CO, мкг/м³

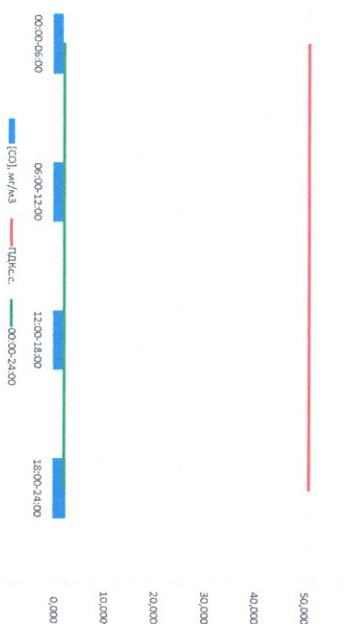

SO₂, мкг/м³

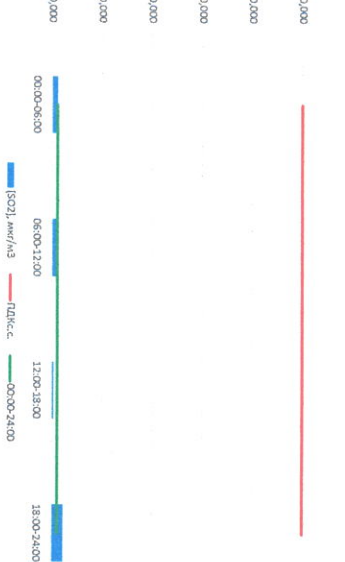

Пыль, мкг/м³

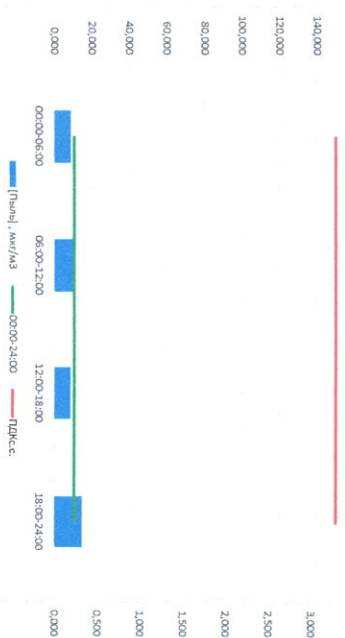

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Есеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

