



| Наименование     | [NO], мкг/м³ | [NO2], мкг/м³                    | [CO], мкг/м³                     | [SO2], мкг/м³                    | [Пыль], мкг/м³                   | Формальдегид, мкг/м³ |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 00:00-06:00      | СВ 48        | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | 0,0003               |
| 06:00-12:00      | СВ 21        | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | 0,0004               |
| 12:00-18:00      | С 5          | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | 0,0004               |
| 18:00-24:00      | С 2          | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | 0,0004               |
| 00:00-24:00      | СВ 19        | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | Оборудование находится в поверке | 0,0004               |
| ПДК <sub>г</sub> |              |                                  |                                  |                                  |                                  | 0,01                 |


Формальдегид, мкг/м³

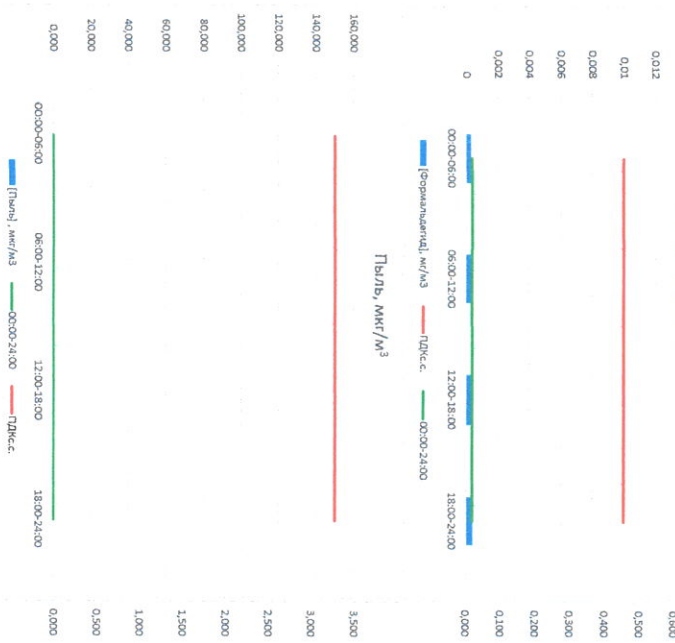

NO, мкг/м³

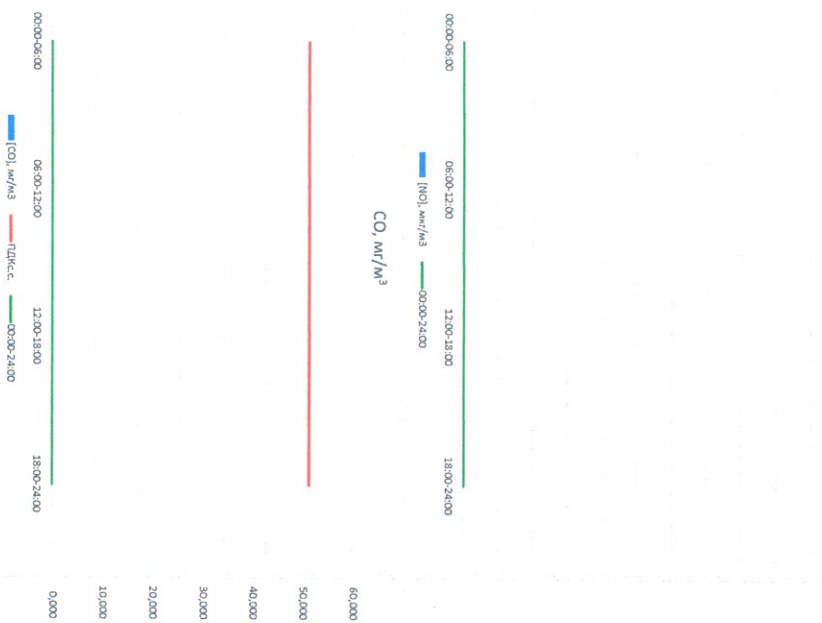

NO2, мкг/м³

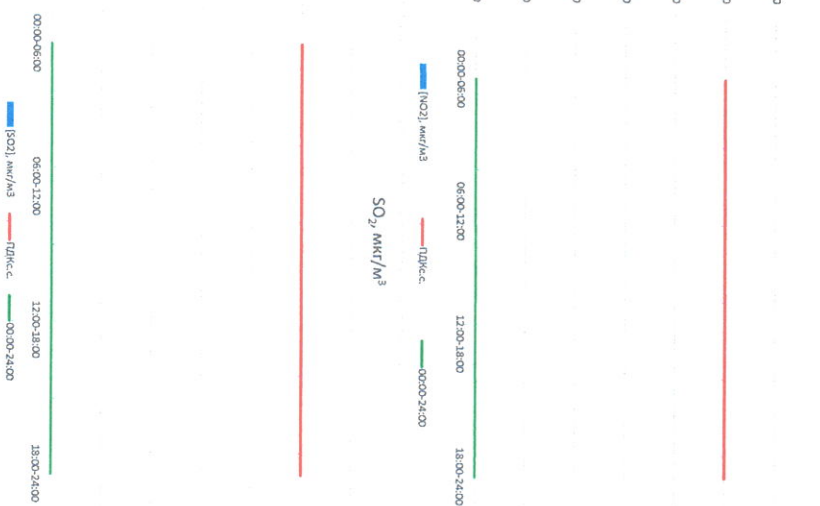


Пыль, мкг/м³



CO, мкг/м³



SO2, мкг/м³

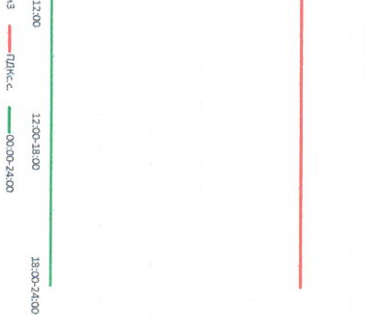

Руководитель филиала ЦЛМТИ по Смоленской области

*[Signature]*

Ю.И. Евсеев

Начальник лаборатории

*[Signature]*

В.Н. Прокопенкова

