



Наименование	NO, мкг/м³	NO2, мкг/м³	CO, мкг/м³	CO2, мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Оборудование находится в поверке
00:00-06:00	172	0,000	2,894	0,124	0,126	9,072
06:00-12:00	ЮКЗ 200	0,577	6,125	0,147	0,089	15,559
12:00-18:00	ЮКЗ 210	3,709	17,420	0,102	0,255	6,486
18:00-24:00	ЮКЗ 205	0,012	4,526	0,073	0,673	13,887
00:00-24:00	ЮКЗ 202	1,075	7,741	0,112	0,286	11,251
ПДКк	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
						0,01


Формальдегид, мкг/м³

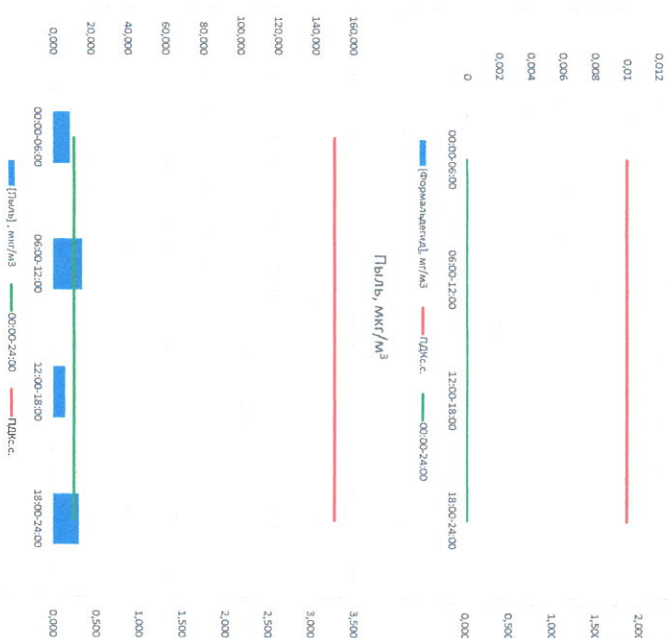


NO, мкг/м³

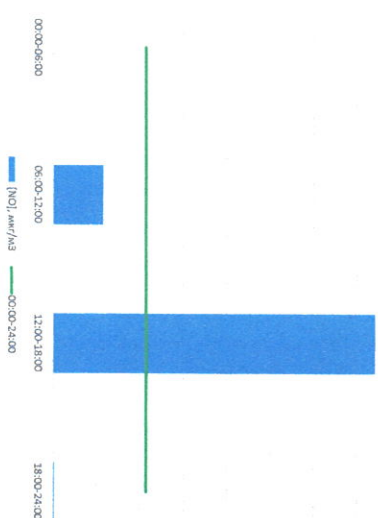


NO2, мкг/м³

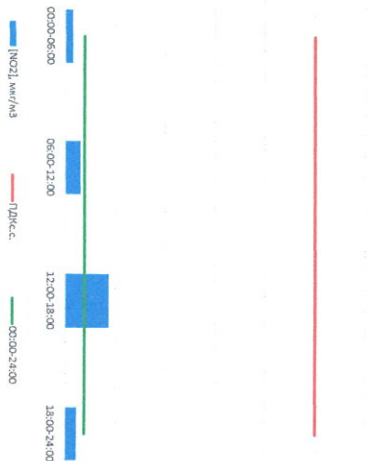


CO, мкг/м³

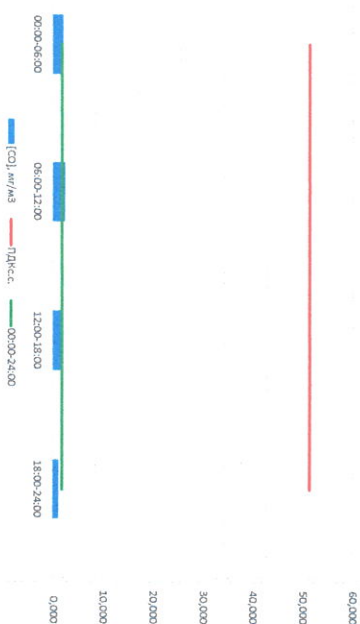

SO2, мкг/м³

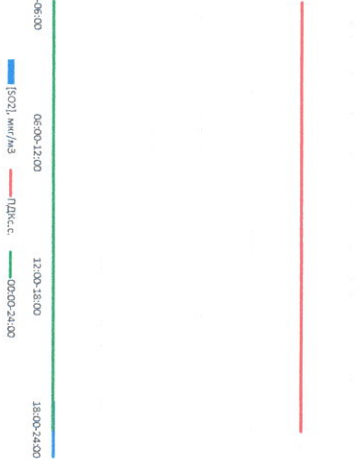

Пыль, мкг/м³

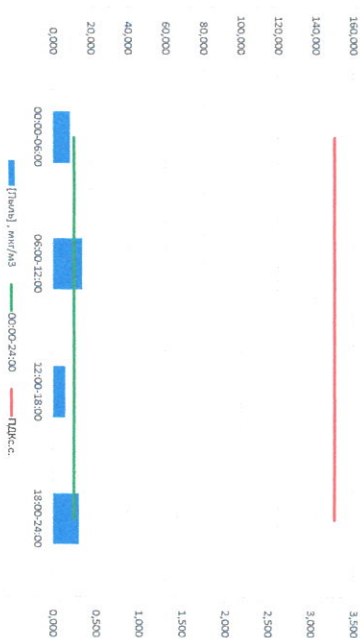

Заместитель руководителя филиала ЦАТИ по

Смоленской области

В.Н. Горбунова

И.о. начальника лаборатории

Ю.А. Черуша

