


Наименование	[NO] мкг/м³	[NO2] мкг/м³	[CO] мкг/м³	[SO2] мкг/м³	[ПМ10] мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	181					0,0004
06:00-12:00	177					0,0004
12:00-18:00	NO3 223					0,0003
18:00-24:00	NO3 226					0,0004
00:00-24:00	NO3 203					0,0004
ПДК, %						0,01

Формальдегид, мкг/м³



NO, мкг/м³

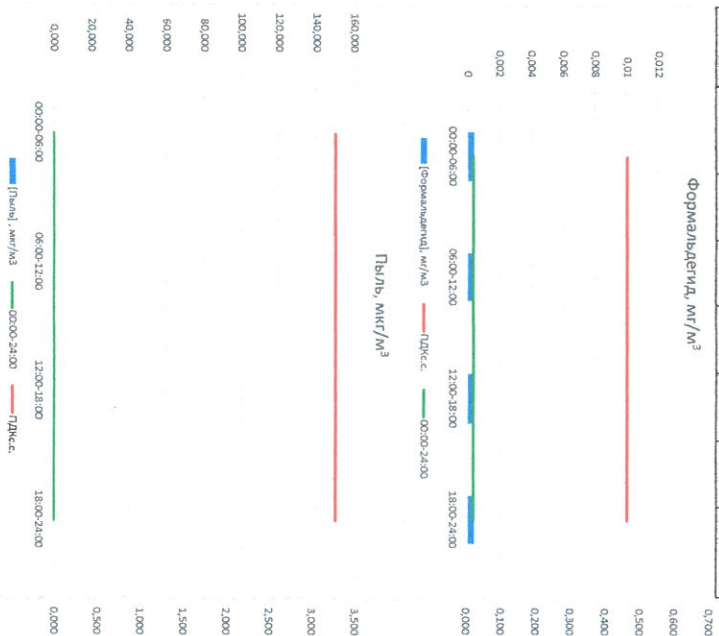


NO2, мкг/м³



CO, мкг/м³



SO2, мкг/м³

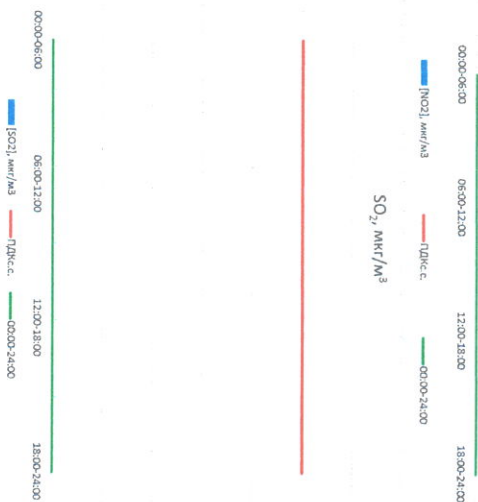

Пыль, мкг/м³



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

[Signature]

Ю.П. Евсеев


Начальник лаборатории

[Signature]


В.И. Прохоренкова

Начало	Конец	Наименование	NO1, мкг/м³	NO2, мкг/м³	CO, мкг/м³	SO2, мкг/м³	ПДК, с.с.	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	NO3 226	Оборудование находится в поверке						0,0004
06:00-12:00	NO3 206	Оборудование находится в поверке						0,0004
12:00-18:00	NO3 219	Оборудование находится в поверке						0,0004
18:00-24:00	NO3 201	Оборудование находится в поверке						0,0004
00:00-24:00	NO3 213	Оборудование находится в поверке						0,0004
ПДК, с.с.		100,0	3,0	50,0	150,0			0,01

Формальдегид, мкг/м³

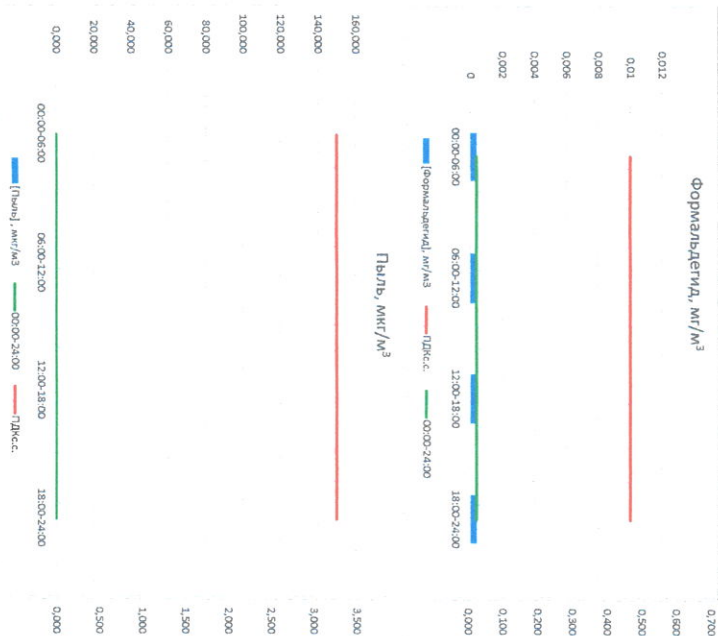


NO, мкг/м³

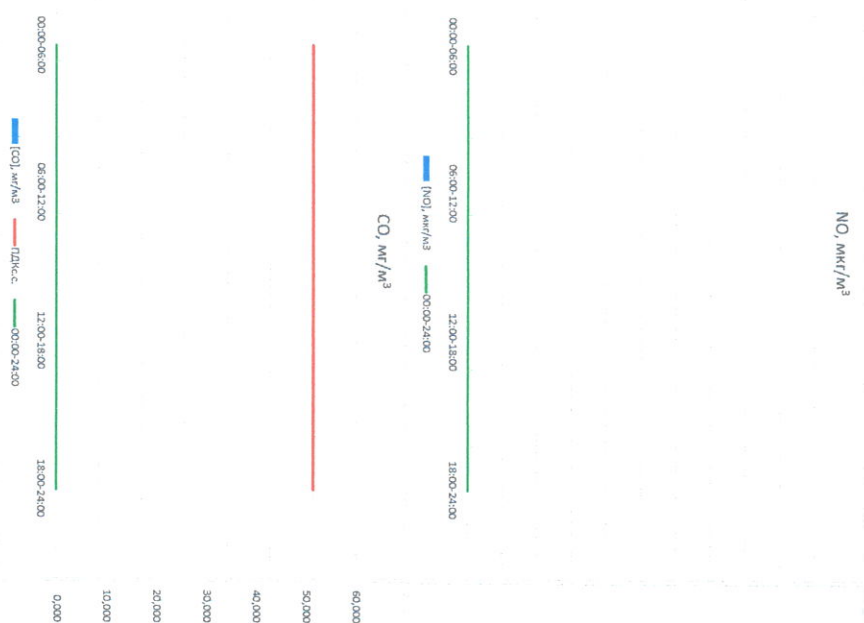


NO2, мкг/м³




CO, мкг/м³

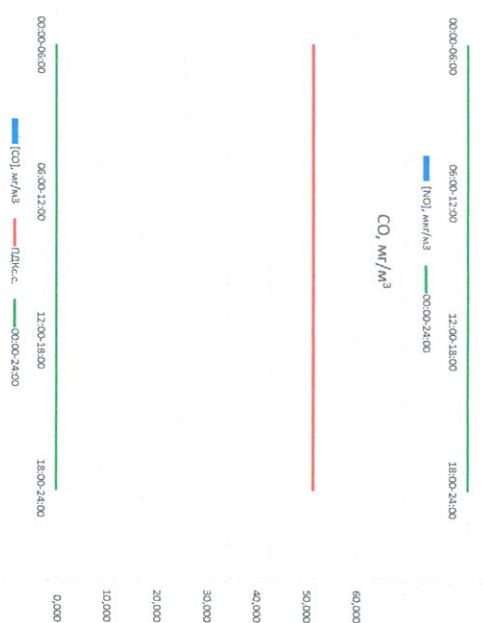

SO2, мкг/м³

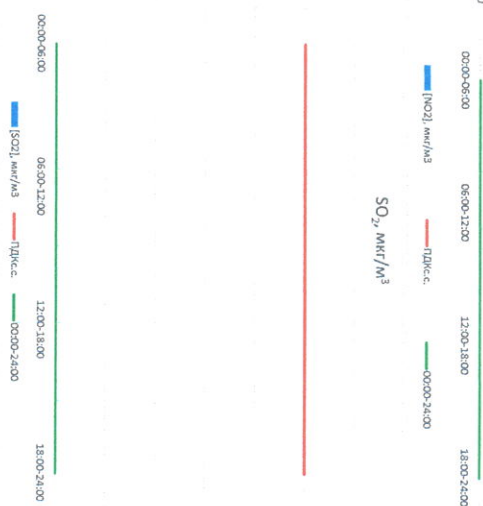

Пыль, мкг/м³

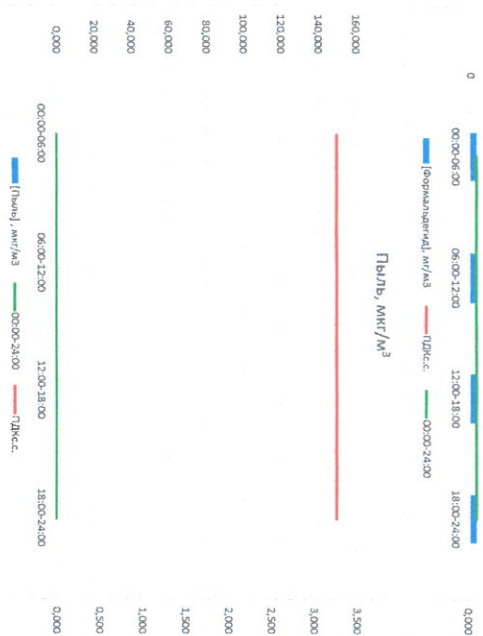

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.П. Прокопченко

