



Наименование	NO ₂ , мкг/м³	NO ₂ , мкг/м³	CO, мкг/м³	SO ₂ , мкг/м³	Пыль, мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	188	0,187	4,991	0,092	0,968	5,968
06:00-12:00	216	1,293	8,158	0,143	1,814	18,084
12:00-18:00	263	0,975	10,756	0,101	0,701	6,553
18:00-24:00	219	0,387	8,457	0,034	0,000	14,777
00:00-24:00	222	0,710	8,090	0,093	0,871	11,346
ПДК-с	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0
Оборудование находится в поверке	0,01					

Формальдегид, мкг/м³

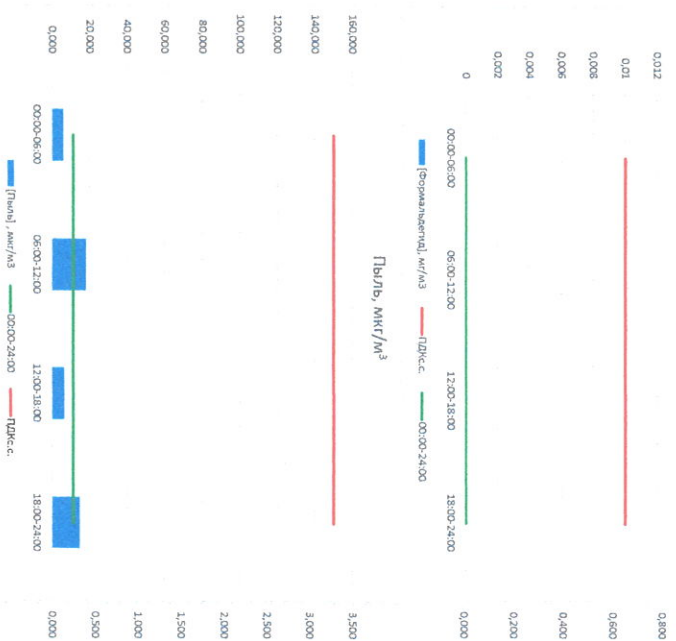


NO₂, мкг/м³

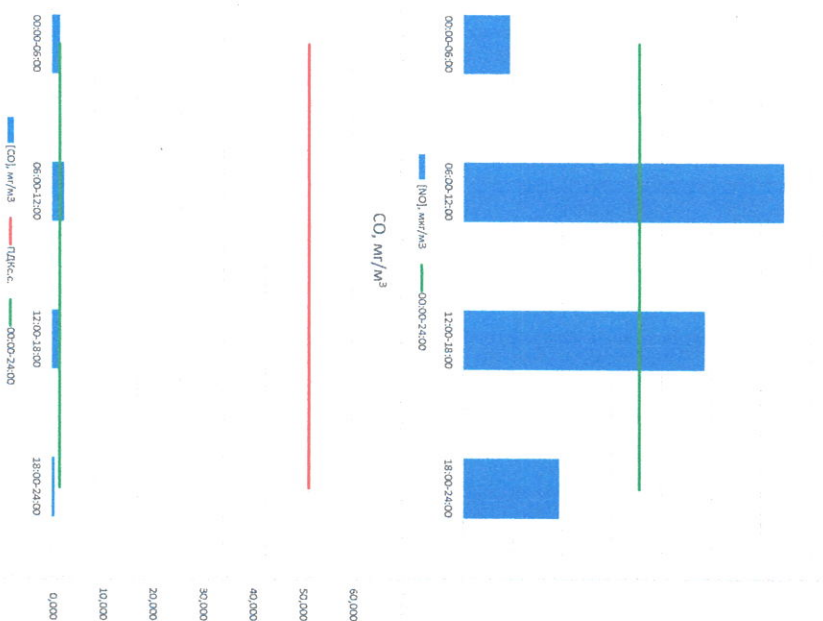


NO₂, мкг/м³




CO, мкг/м³

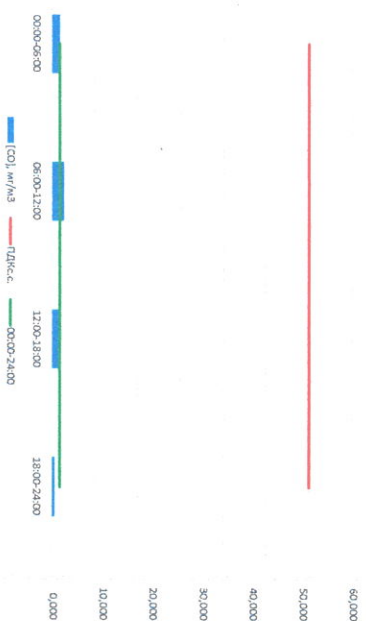

SO₂, мкг/м³

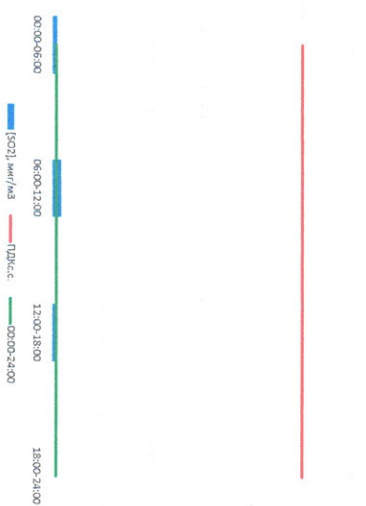

Пыль, мкг/м³

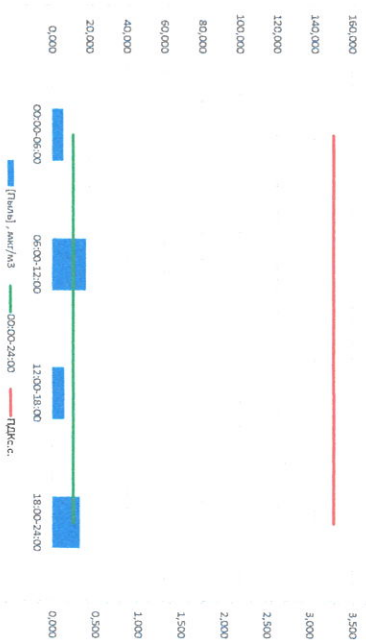

Заместитель руководителя филиала ЦПАТИ по Смоленской области

В.И. Горбунова

И.а. Ивашкина, лаборант

Ю.А. Черныш

