


Измерение время	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[PM10], мкг/м³	Оборудование находится в поверке
00:00-06:00	ЗКЗ 292	0,339	3,700	0,328	1,238	8,912
06:00-12:00	ЗКЗ 277	0,210	5,002	0,375	0,471	6,807
12:00-18:00	ЗКЗ 290	0,033	4,257	0,520	0,000	12,316
18:00-24:00	ЗКЗ 241	7,102	6,438	0,445	0,016	19,455
00:00-24:00	ЗКЗ 275	1,921	4,849	0,417	0,431	11,872
ПДК _{кв.}	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³



NO, мкг/м³

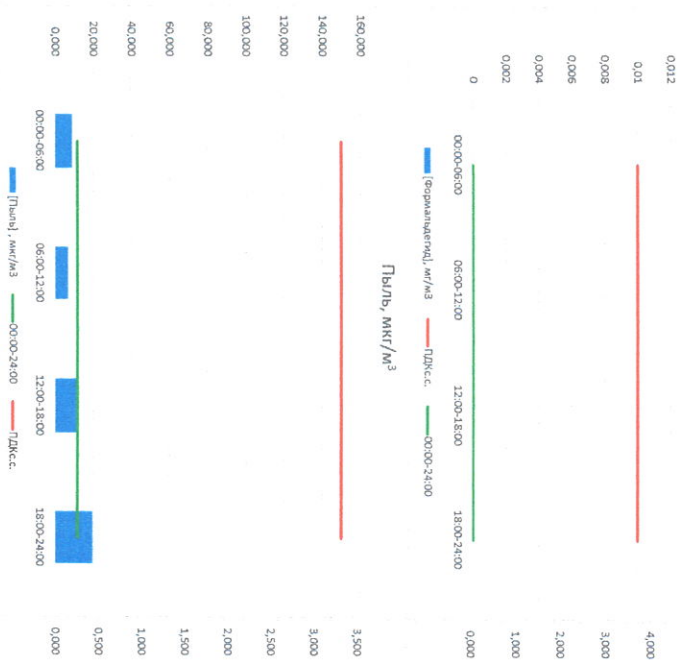


NO2, мкг/м³

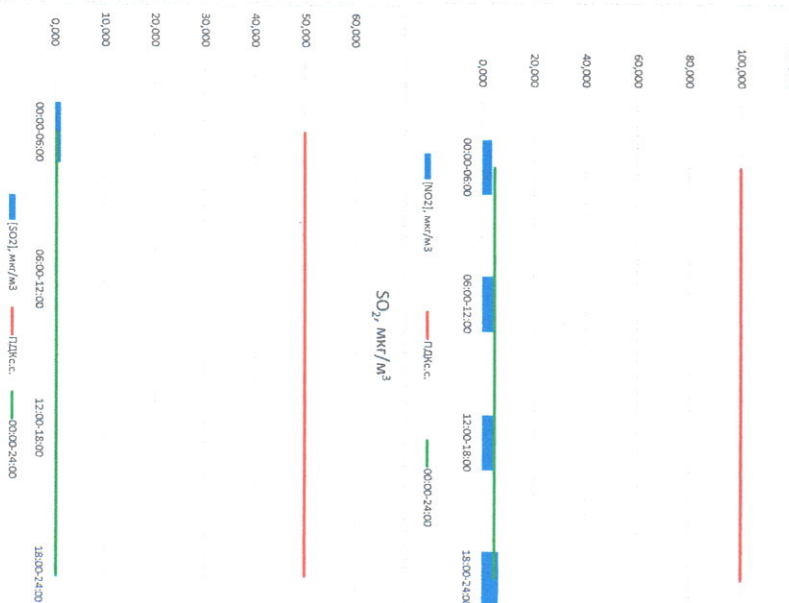

CO, мкг/м³



SO2, мкг/м³

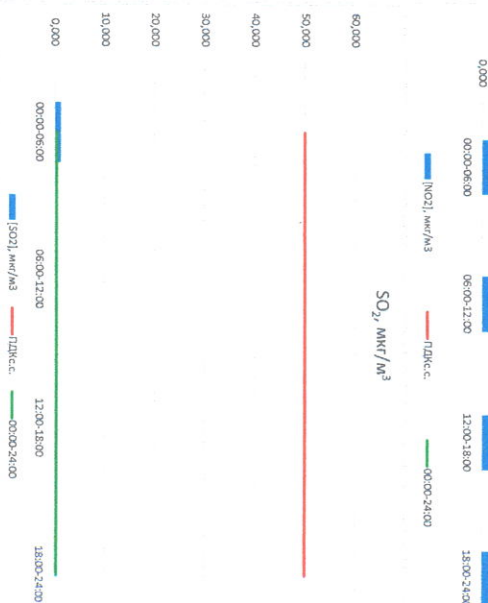

Руководитель филиала ЦАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Инициалы лаборатории

В.Н. Прохоренко

