



Наименование пункта	№ п/п	Норматив	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение
00:00-06:00	СЗ	310							
06:00-12:00	СЗ	343							
12:00-18:00	С	359							
18:00-24:00	СЗ	324							
00:00-24:00	СЗ	334							
ПДК <sub>с</sub>			100,0	3,0	50,0	150,0			
			0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,01


Формальдегид, мг/м³

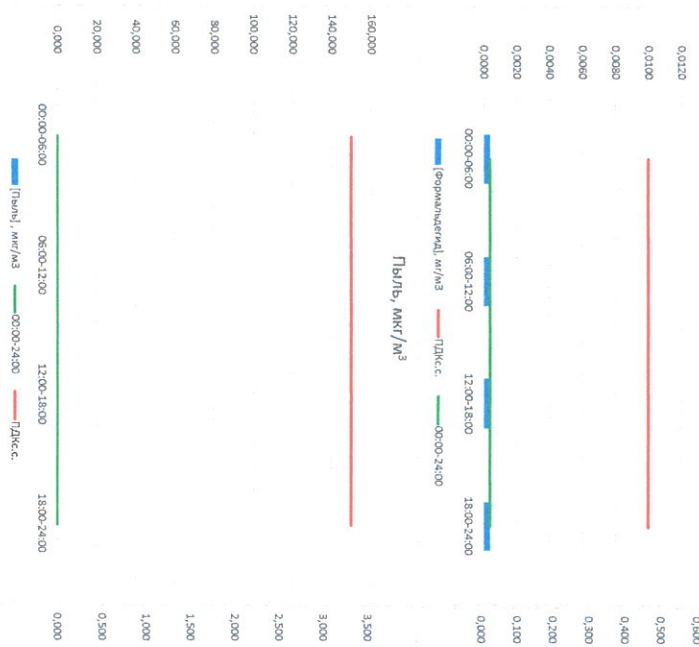


NO, мкг/м³

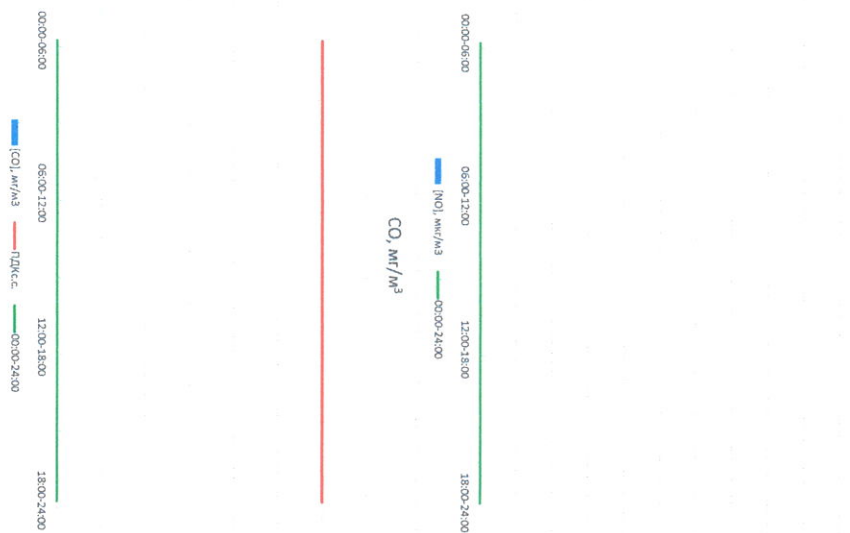

NO<sub>2</sub>, мкг/м³

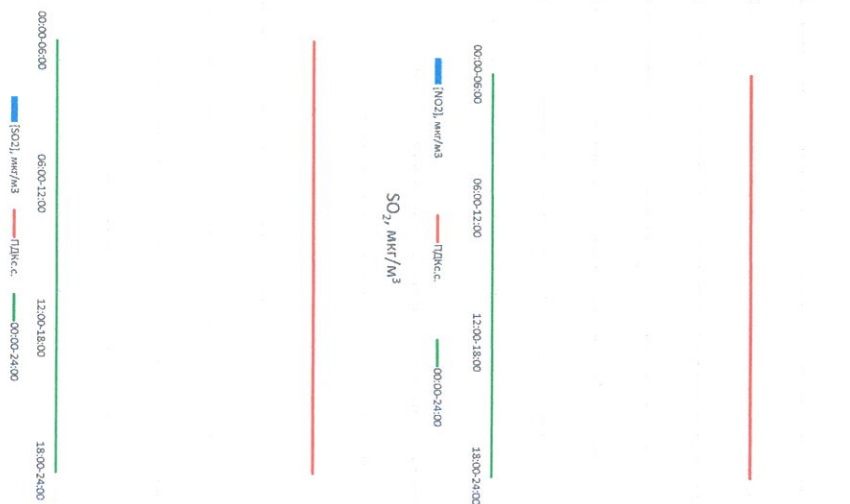


CO, мг/м³

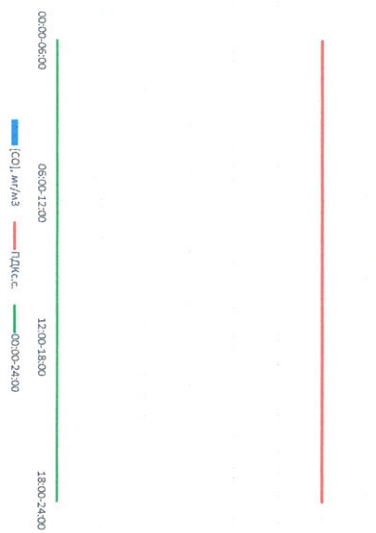

SO<sub>2</sub>, мкг/м³



Пыль, мкг/м³

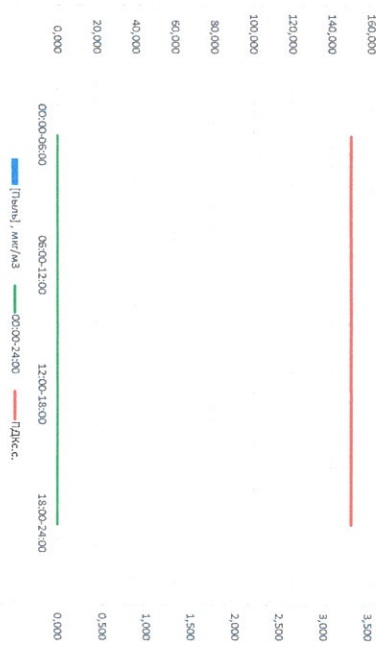

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренкова

