



Наименование	[NO ₂], мкг/м ³	[NO ₂], мкг/м ³	[CO], мкг/м ³	[SO ₂], мкг/м ³	[Пыль], мкг/м ³	Оборудование находится в
00:00-06:00	191	4,249	3,977	0,218	0,377	11,271
06:00-12:00	109	3,022	10,491	0,235	0,105	50,950
12:00-18:00	159	0,000	7,012	0,385	0,000	16,516
18:00-24:00	154	18,346	19,671	0,398	0,000	108,062
00:00-24:00	159	6,404	10,288	0,309	0,120	48,200
ПДК _с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

Формальдегид, мкг/м³

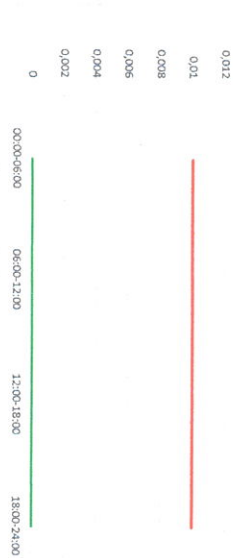


Пыль, мкг/м³

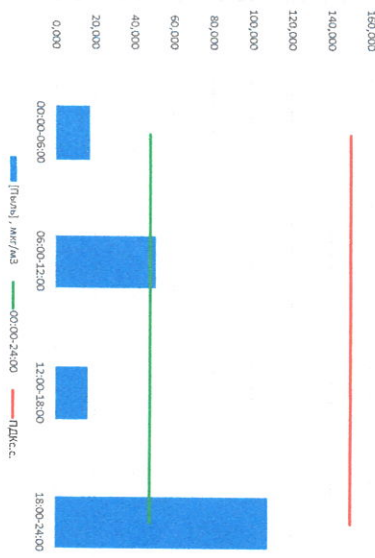


NO, мкг/м³




CO, мкг/м³

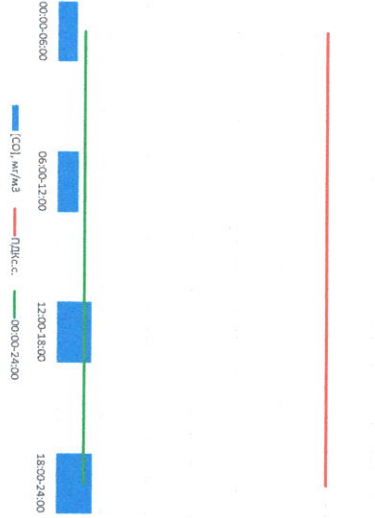

NO₂, мкг/м³

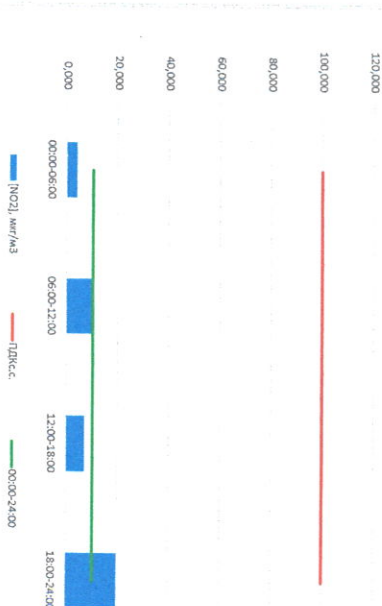

SO₂, мкг/м³

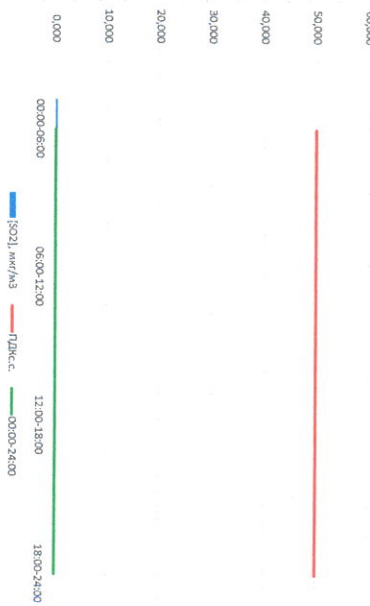

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренкова

