



Направление ветра	[NO] мкг/м³	[NO2] мкг/м³	[CO] мкг/м³	[SO2] мкг/м³	[Пыль] мкг/м³	[Формальдегид] мкг/м³
00:00-06:00	ЭКЗ 296	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	0,0004
06:00-12:00	ЭКЗ 240	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	0,0004
12:00-18:00	ЭКЗ 196	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	0,0004
18:00-24:00	ЭКЗ 243	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	0,0004
00:00-24:00	ЭКЗ 244	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	0,0004
ПДК, с	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

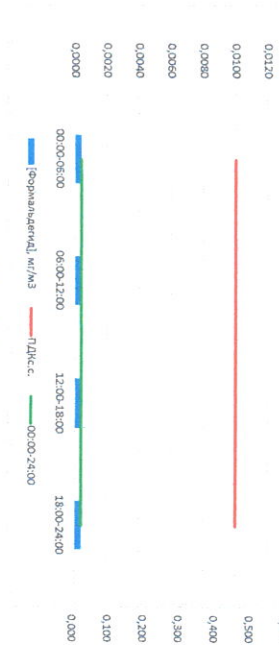


Пыль, мкг/м³

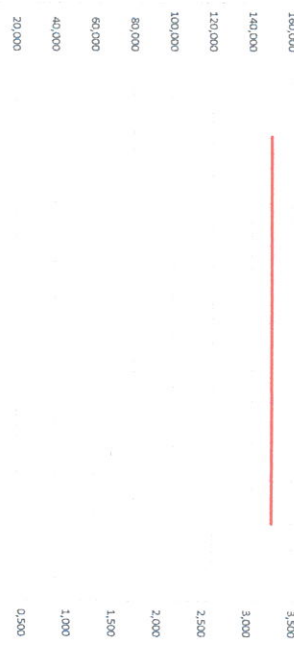

NO, мкг/м³

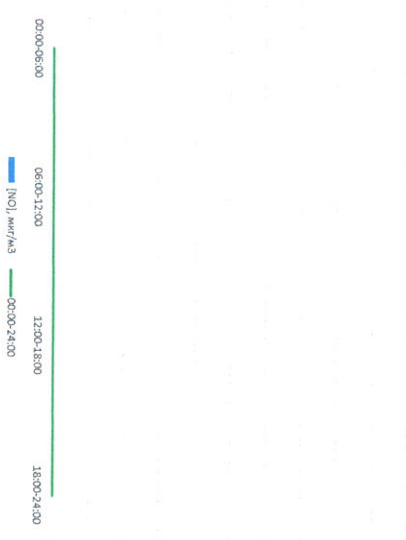


CO, мкг/м³

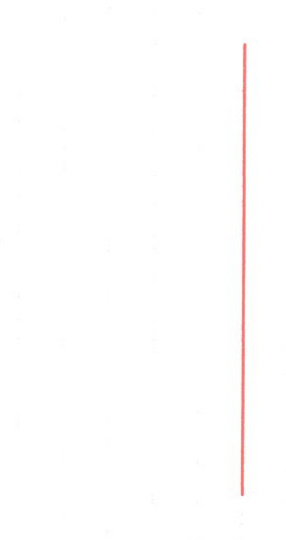

NO2, мкг/м³



SO2, мкг/м³

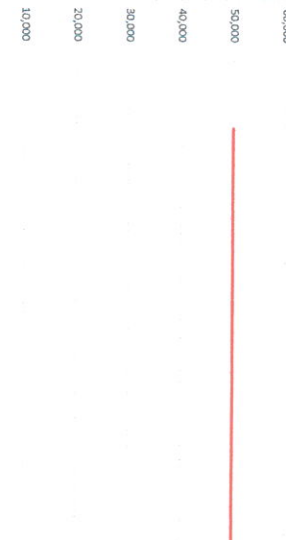

Руководитель филиала ЦЛТИ

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохорова

