



Наименование	№	№	№	№	№	№	№	№	№
00:00-06:00	КОВ	146	147	148	149	150	151	152	153
06:00-12:00	КОВ	131	132	133	134	135	136	137	138
12:00-18:00	КОВ	140	141	142	143	144	145	146	147
18:00-24:00	КОВ	127	128	129	130	131	132	133	134
00:00-24:00	КОВ	136	137	138	139	140	141	142	143
ПДК _{г.с.}									


Формальдегид, мг/м³

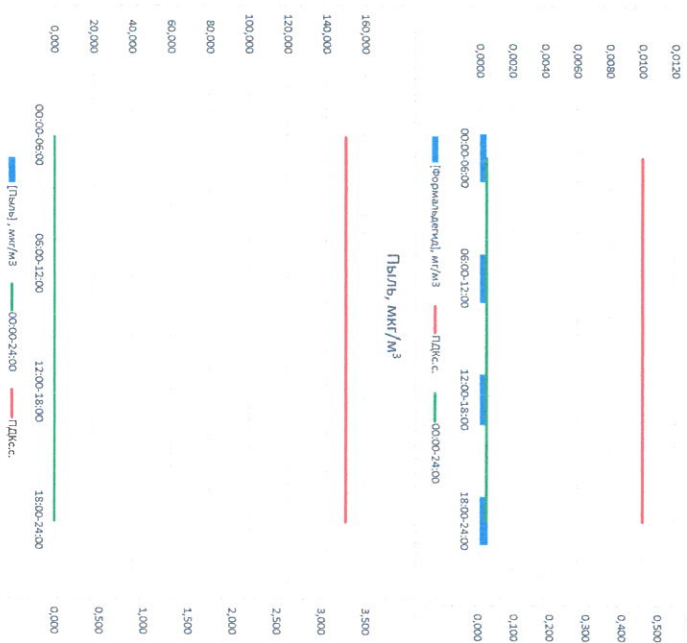


NO, мкг/м³

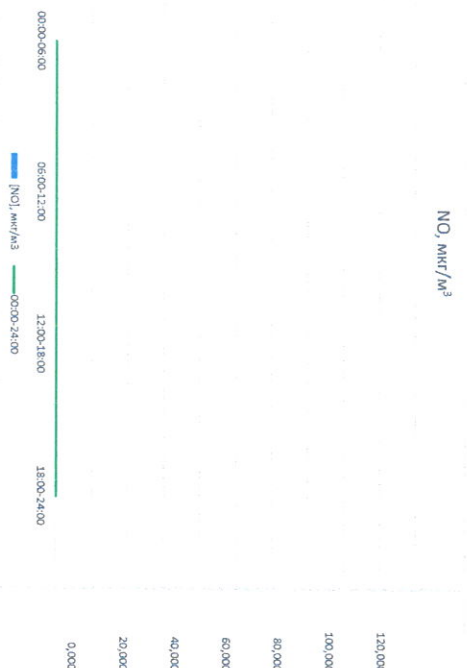


NO₂, мкг/м³

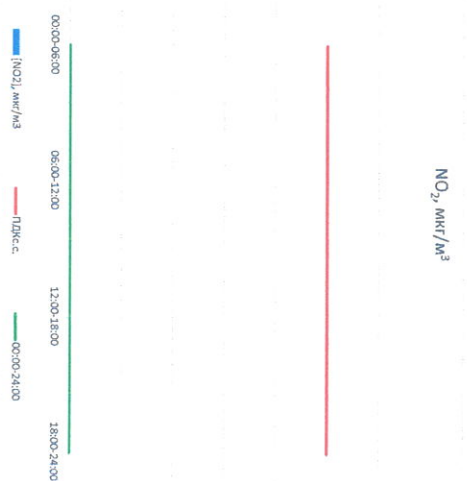


CO, мг/м³

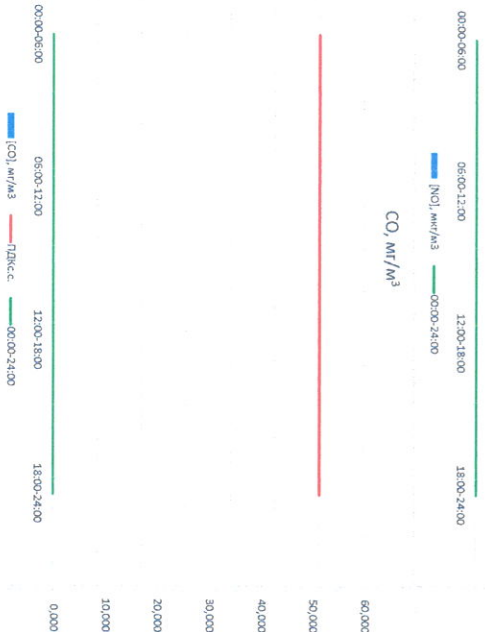

SO₂, мкг/м³

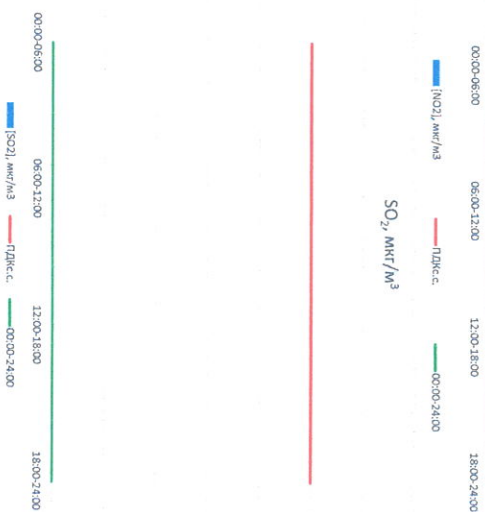

Пыль, мкг/м³

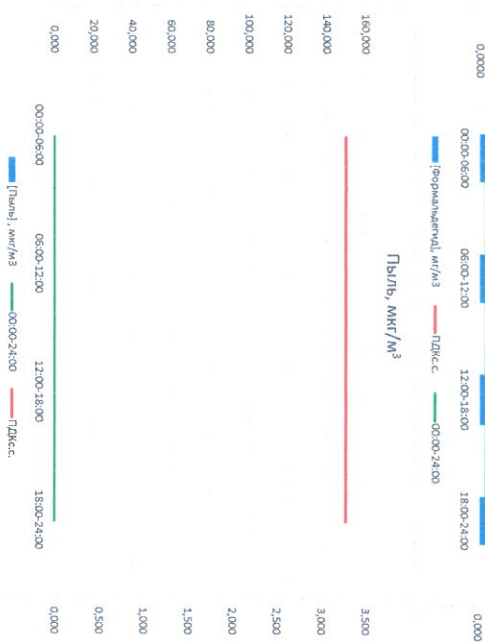

Результаты измерений в лаборатории


Ю.П. Есеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прокопченко

Начало периода	Начало периода	Начало периода	Начало периода	Начало периода	Начало периода	Начало периода
00:00-06:00	Всё в 110	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
06:00-12:00	Всё в 87	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
12:00-18:00	Всё в 64	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
18:00-24:00	Всё в 49	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
00:00-24:00	Всё в 78	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке
ПДК, с	Всё в 78	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке	Оборудование находится в поверке

Формальдегид, мг/м³

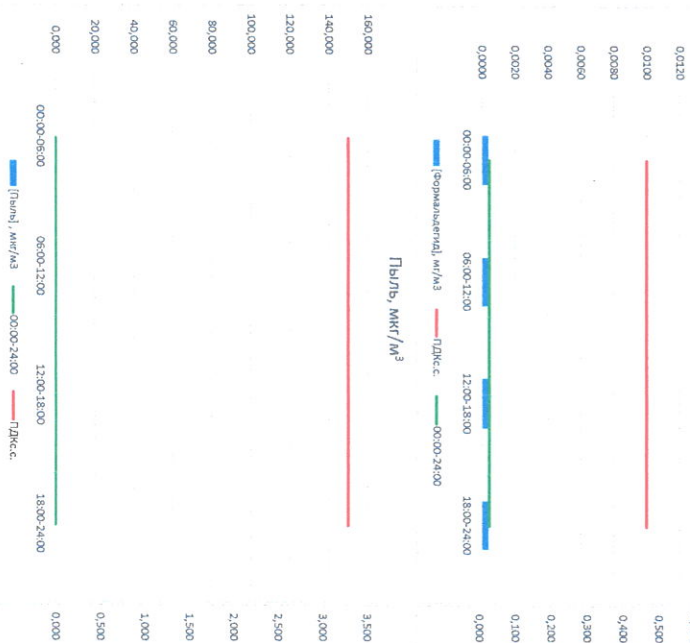

Пыль, мкг/м³



NO, мкг/м³



NO₂, мкг/м³



CO, мкг/м³



SO₂, мкг/м³



Руководитель лаборатории

Ю.П. Есеев


Начальник лаборатории

В.Н. Прокопцова




Наименование аэрозоля	[NO ₂], мкг/м ³	[NO ₂], мкг/м ³	[CO], мкг/м ³	[SO ₂], мкг/м ³	[Пыль], мкг/м ³	[Формальдегид], мкг/м ³
00:00-06:00	ССВ	29				0,0004
06:00-12:00	ССВ	16				0,0004
12:00-18:00	С	9				0,0004
18:00-24:00	С	1				0,0004
00:00-24:00	ССВ	14				0,0004
ПДК _с		100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³

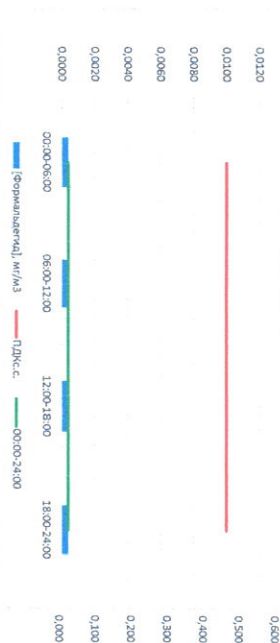

[Пыль], мкг/м³

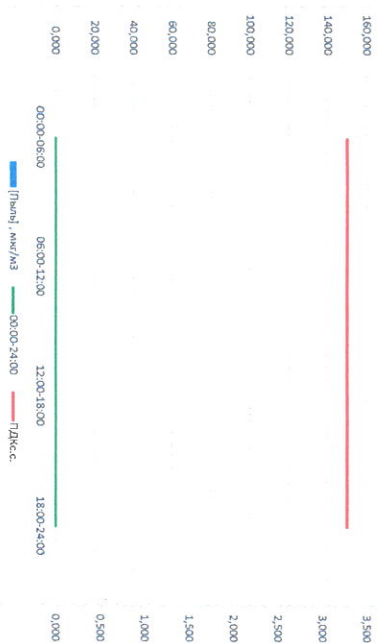

NO, мкг/м³

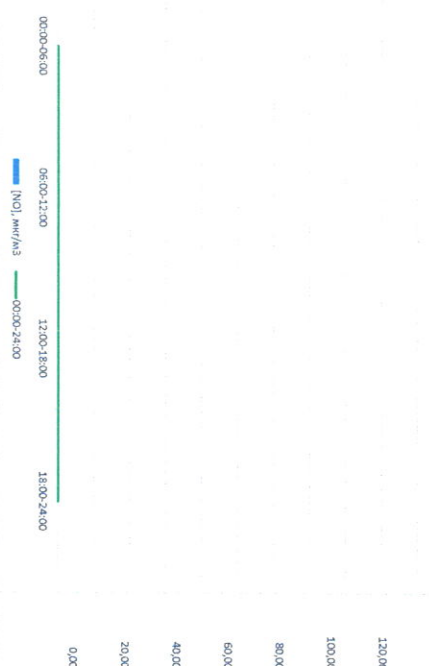

CO, мкг/м³



NO₂, мкг/м³



SO₂, мкг/м³



Руководитель филиала ПЛАТИ по Смоленской области

Ю.И. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренкова

