



Наименование	[NO] мкг/м³	[NO2] мкг/м³	[CO] мкг/м³	[SO2] мкг/м³	[ПДКк.с.] мкг/м³	[ПДКс.с.] мкг/м³
00:00-06:00	С 319					
06:00-12:00	ЭСЗ 296					
12:00-18:00	СЗ 260					
18:00-24:00	ЭОЗ 239					
00:00-24:00	ЭСЗ 286					
ПДК <sub>с.с.</sub>		100,0	3,0	50,0	150,0	0,01

Формальдегид, мкг/м³

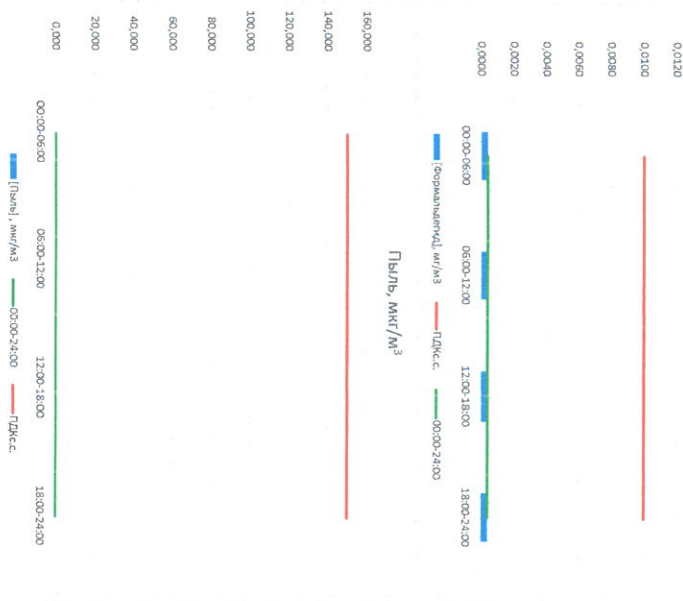


NO, мкг/м³

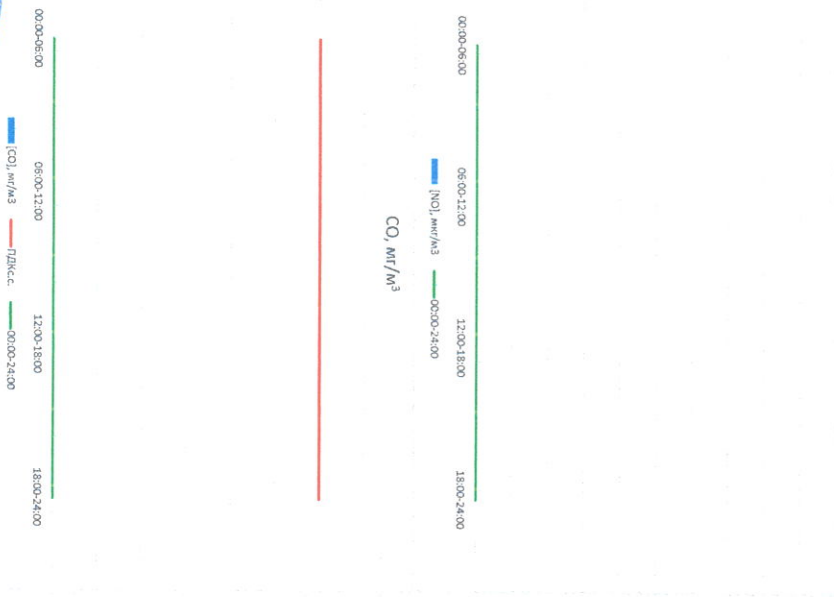


NO<sub>2</sub>, мкг/м³



CO, мкг/м³

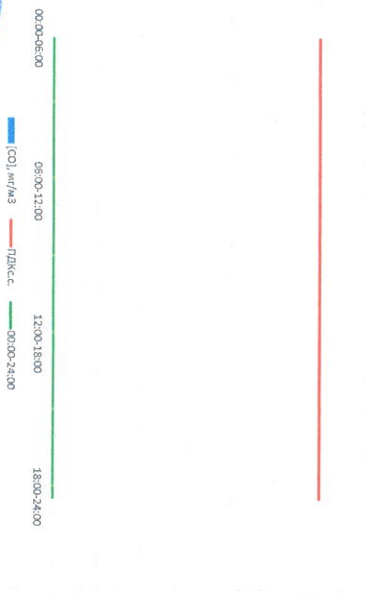

SO<sub>2</sub>, мкг/м³

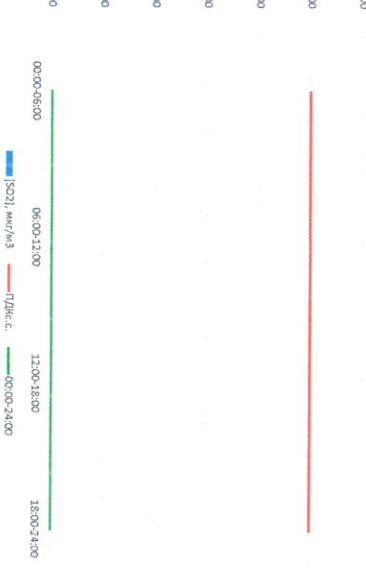

Руководитель филиала ПЛАТНИ


Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории


В.Н. Прохоренкова

Наименование	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
00:00-06:00	NO2	228	Оборудование находится в поверке	1000.0	Оборудование находится в поверке	3.0	Оборудование находится в поверке
06:00-12:00	ЭКЗ	250	Оборудование находится в поверке	1000.0	Оборудование находится в поверке	50.0	Оборудование находится в поверке
12:00-18:00	ЭКЗ	291	Оборудование находится в поверке	1000.0	Оборудование находится в поверке	50.0	Оборудование находится в поверке
18:00-24:00	СЗ	316	Оборудование находится в поверке	1000.0	Оборудование находится в поверке	50.0	Оборудование находится в поверке
00:00-24:00	З	271	Оборудование находится в поверке	1000.0	Оборудование находится в поверке	50.0	Оборудование находится в поверке
ПДК, с	-	-	-	-	-	-	-


ФОРМАЛЬДЕГИД, мг/м³

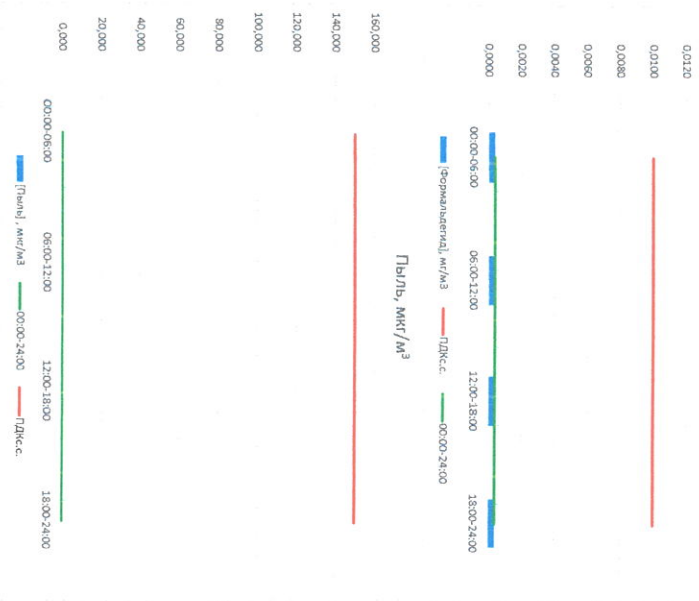

NO, мкг/м³

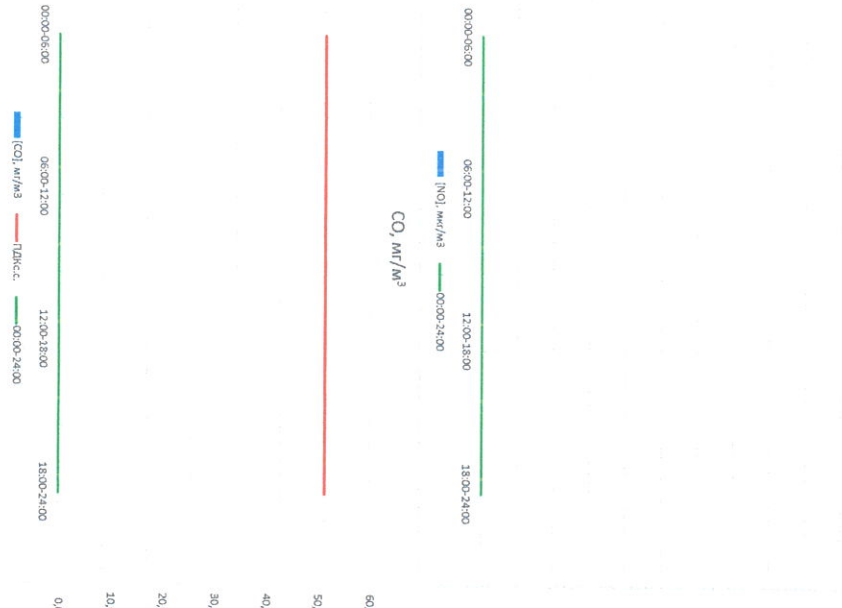


NO2, мкг/м³

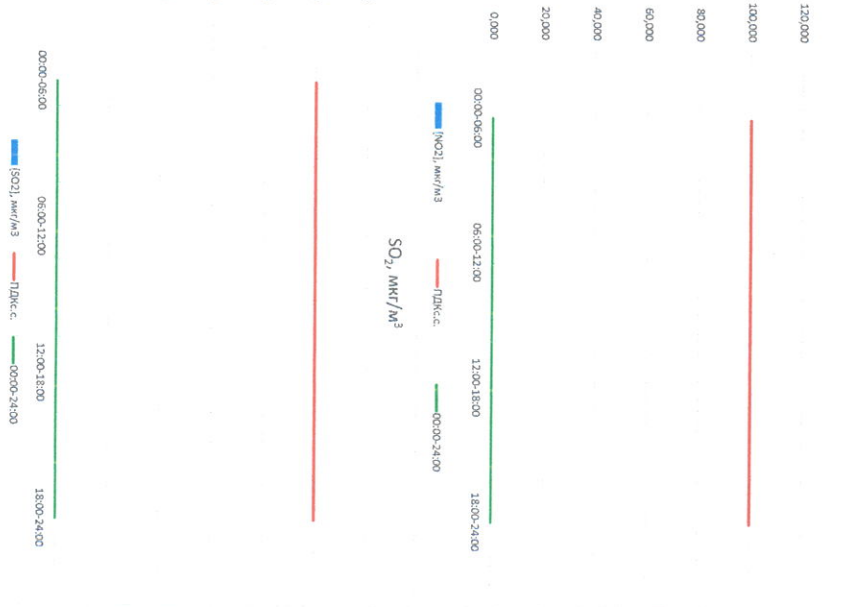

CO, мг/м³



SO2, мкг/м³

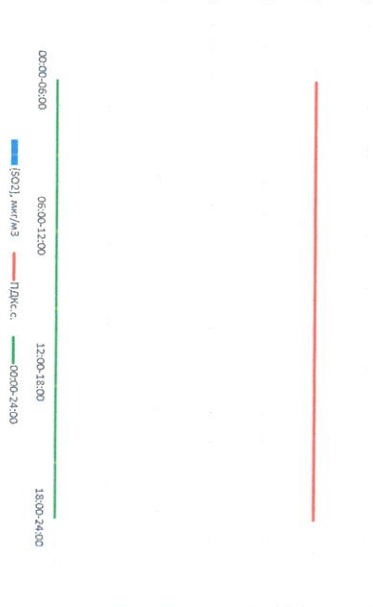

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев


Начальник лаборатории

В.Н. Прохвешкина



Наименование	NO <sub>x</sub> , мкг/м <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> , мкг/м <sup>3</sup>	CO, мкг/м <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> , мкг/м <sup>3</sup>	Пыль, мкг/м <sup>3</sup>	Формальдегид, мкг/м <sup>3</sup>
00:00-06:00	СЗ 310	Э 276	СЗ 283	СЗ 306	СЗ 294	100,0
06:00-12:00	Э 276	СЗ 283	СЗ 306	СЗ 294	100,0	3,0
12:00-18:00	СЗ 283	СЗ 306	СЗ 294	100,0	150,0	150,0
18:00-24:00	СЗ 283	СЗ 306	СЗ 294	100,0	150,0	150,0
00:00-24:00	СЗ 283	СЗ 306	СЗ 294	100,0	150,0	150,0
ПДК, с	-	-	-	-	-	-


Формальдегид, мкг/м<sup>3</sup>

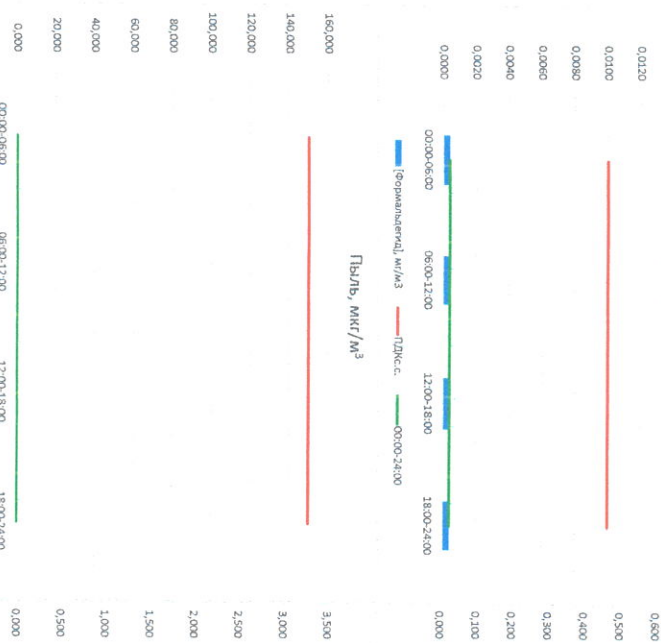


NO, мкг/м<sup>3</sup>




NO<sub>2</sub>, мкг/м<sup>3</sup>

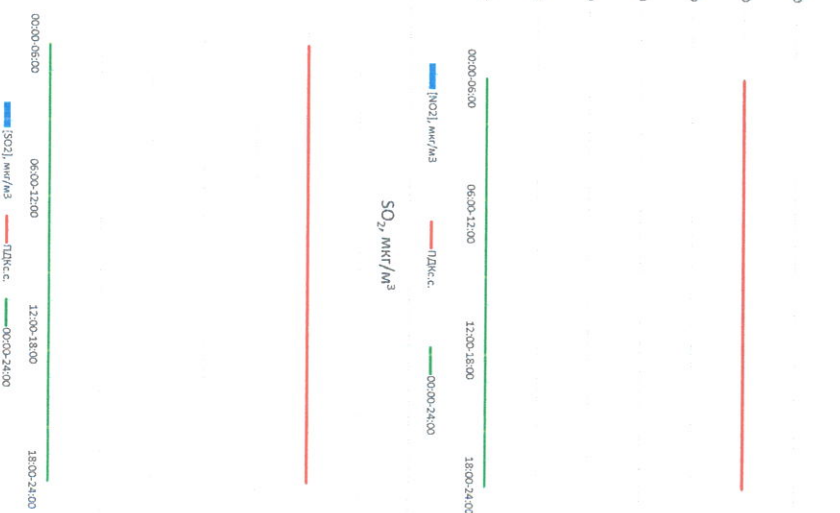


CO, мкг/м<sup>3</sup>

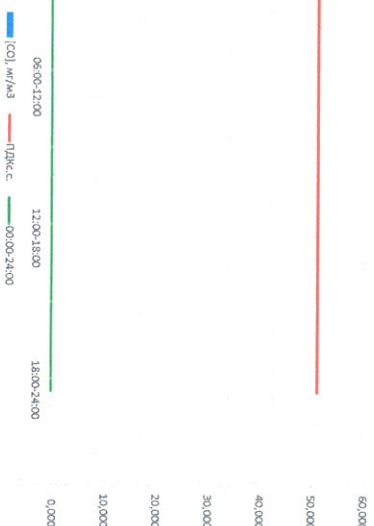

SO<sub>2</sub>, мкг/м<sup>3</sup>

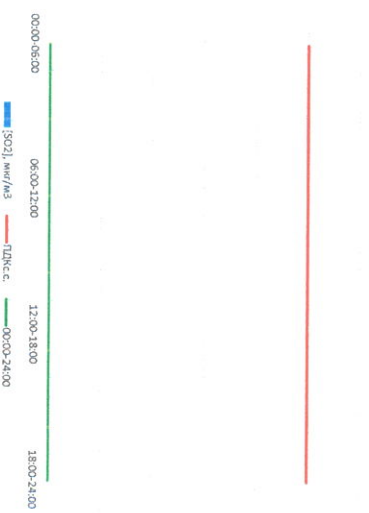

Пыль, мкг/м<sup>3</sup>

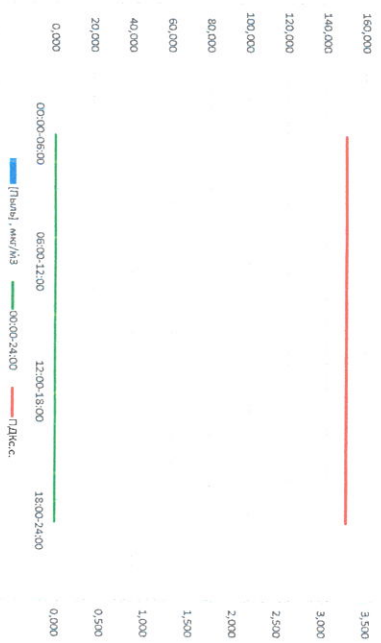

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Самарской области

Ю.П. Евсеев


Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренко




Наименование	[NO] мкг/м³	[NO2] мкг/м³	[CO] мкг/м³	[SO2] мкг/м³	[SO2] <sub>г</sub> мкг/м³	Формальдегид, мкг/м³
00:00-06:00	СЗ 280	Оборудование находится в поверке	100,0	3,0	50,0	Оборудование находится в поверке
06:00-12:00	СЗ 280	Оборудование находится в поверке	0,0004	0,0004	0,0004	Оборудование находится в поверке
12:00-18:00	З 269	Оборудование находится в поверке	0,0004	0,0004	0,0004	Оборудование находится в поверке
18:00-24:00	З 240	Оборудование находится в поверке	0,0004	0,0004	0,0004	Оборудование находится в поверке
00:00-24:00	З 270	Оборудование находится в поверке	0,0004	0,0004	0,0004	Оборудование находится в поверке
ПДК, с	3	3	100,0	3,0	50,0	150,0


Формальдегид, мкг/м³

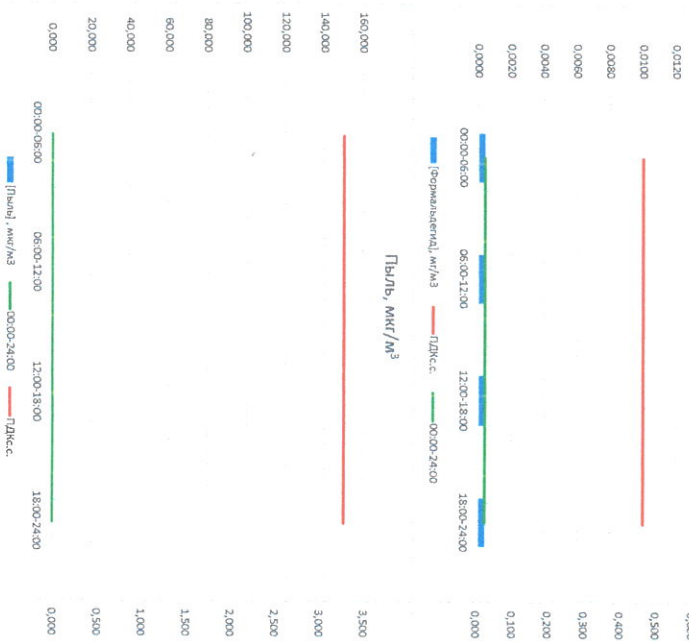


NO, мкг/м³

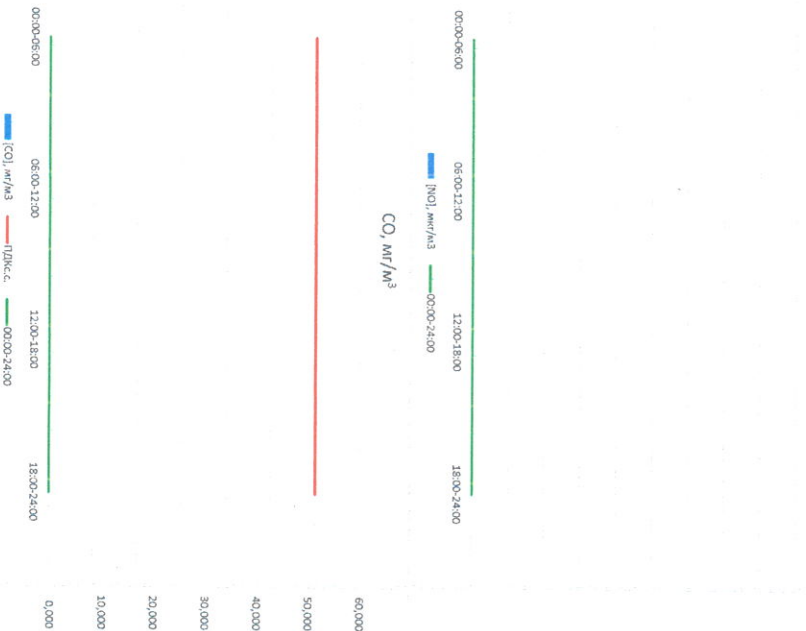

NO<sub>2</sub>, мкг/м³

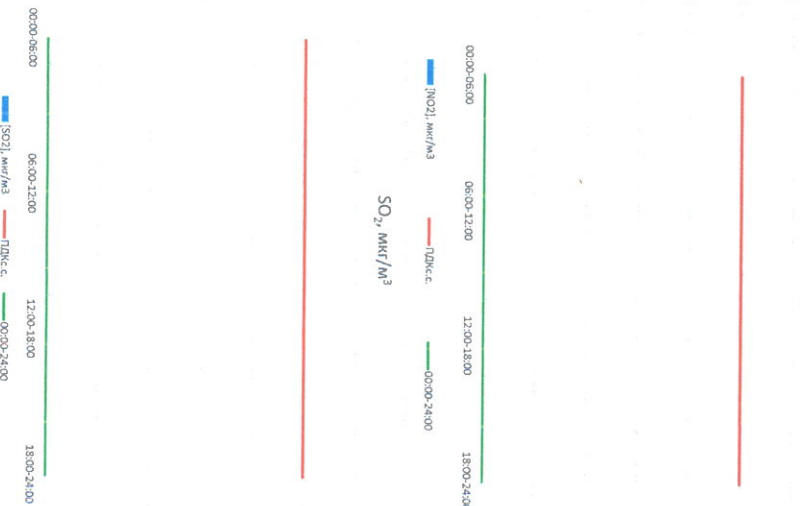

Пыль, мкг/м³

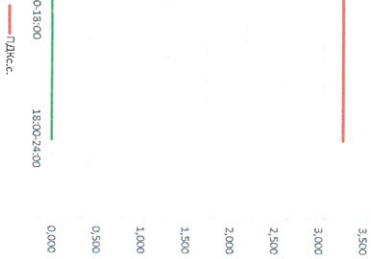

CO, мкг/м³



SO<sub>2</sub>, мкг/м³



Руководитель филиала ЦИАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прохоренкова

